



Warszawa, 30.06.2026 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. 16/P /26/DZP



Platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania na „Poprawę dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia – Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ – etap II, część I” – nr postępowania 14/2026/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ na „Poprawę dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia – Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ – etap II, część I” – nr postępowania 14/2026/DZP

Pyt. 1

dotyczy – Część 5

Czy Zamawiający dopuści ilość pojemników 0.5l w opakowaniu zbiorczym 140 sztuk, zamiast podanych w pkt. 42 Opisu Przedmiotu Zamówienia -120 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ilość i opakowanie opisane w pytaniu.

Pyt. 2

dotyczy – Część 5

W punkcie 53 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający w kolumnie „Parametr Wymagany” nie potwierdził „TAK” jako wymóg opisany: „*Ilości formaliny do dostarczenia wraz z urządzeniem: min. 100 litrów*”.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem minimum 100 litrów formaliny.

Odp.: Tak, Zamawiający wraz z urządzeniem wymaga dostarczenia minimum 100 litrów formaliny

Pyt. 3

dotyczy Część 5

Czy w przytoczonym wymaganiu określonym w punkcie 4 w „II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU” nie doszło do omyłki lub omyłkowego przypisania warunku do niniejszej Części?



Zapis dotyczy urządzenia lub jego elementów podlegających sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu albo sterylizacji plazmowej, a także ewentualnego demontażu przed procesem dekontaminacji, podczas gdy przedmiotowy Pakiet obejmuje duże urządzenie, a nie narzędzia ani elementy wymagające standardowej sterylizacji w Centralnej Sterylizatorni.

W przypadku gdy zapis został zamieszczony omyłkowo, prosimy o jego usunięcie.

Odp.: Zamawiający w załączniku nr 2.5 do SWZ Formularz właściwości techniczno – użytkowych Urządzenia objętego częścią 5 zamówienia w dziale II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU II. GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU – w związku z omyłką pisarską – wykreśla punkt 4.

Pyt.4

Część 6 - Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów – 1 szt.

Dot. pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora o wymiarach zewnętrznych 662 x 2200 x 787 mm (szer. x wys. x gł.), przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów funkcjonalnych, użytkowych oraz wydajnościowych urządzenia?

Wykonawca zwraca uwagę, że niewielkie różnice w wymiarach zewnętrznych urządzenia wynikają bezpośrednio z indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez poszczególnych producentów i nie mają wpływu na skuteczność procesu mycia i dezynfekcji, bezpieczeństwo użytkowania ani funkcjonalność urządzenia.

Oferowane urządzenie, pomimo kompaktowej szerokości wynoszącej jedynie około 662 mm, zapewnia załadunek do 12 koszy DIN 1/1, spełniając wymagania stawiane nowoczesnym myjniom-dezynfektorom stosowanym w Centralnych Sterylizatorniach.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 5

Część 6 - Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów – 1 szt.

Dot. pkt. 4 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 1/1 DIN czy inny rozmiar ?

Odp.: Zamawiający wymaga pojemności załadunku 10-12 DIN.

Pyt. 6

Część 6 - Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów – 1 szt.

Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną w pompę obiegową o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia, geometrii komory, zastosowanego systemu natrysku oraz deklarowanej skuteczności mycia, zamiast wymaganej minimalnej wydajności pompy obiegowej wynoszącej 700 l/min?

Zwracamy uwagę, że sama wydajność pompy obiegowej nie stanowi parametru świadczącego o skuteczności procesu mycia i dezynfekcji. Efektywność procesu zależy od całej konstrukcji hydraulicznej urządzenia, w tym układu ramion natryskowych, średnic przewodów, ciśnienia roboczego, geometrii komory oraz konfiguracji wsadu.

Jednocześnie wskazanie konkretnej wartości wydajności pompy na poziomie minimum 700 l/min może prowadzić do preferowania rozwiązań określonego producenta, podczas gdy urządzenia innych renomowanych producentów osiągają porównywalne lub wyższe efekty mycia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych i innych parametrów hydraulicznych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie urządzeń wyposażonych w pompy obiegowe o wydajności wynikającej z przyjętej konstrukcji producenta, pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności procesu z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883 oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza myjnię-dezynfektor wyposażoną w pompę obiegową o wydajności opisanej w pytaniu.

Pyt. 7

Część 6 - Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów – 1 szt.

Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora wyposażonej w wydajny kondensator oparów ograniczający zawilgocenie instalacji wentylacyjnej oraz pomieszczenia, zamiast wymaganego „Skraplacza ESS (system oszczędzania energii)”?

Zwracamy uwagę, że określenie „Skraplacz ESS (system oszczędzania energii)” stanowi nazwę handlową rozwiązania stosowanego przez konkretnego producenta urządzeń i jest używane m.in. w materiałach marketingowych publikowanych przez firmę FM MED dla myjni AT-OS AWD 655. Wymaganie wskazujące na konkretne rozwiązanie handlowe może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji i naruszenia zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp.

Jednocześnie należy podkreślić, że funkcję ograniczenia emisji wilgoci, ochrony instalacji wentylacyjnej oraz poprawy warunków pracy personelu skutecznie realizują również myjni wyposażone w kondensator oparów. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane przez wielu renomowanych producentów myjni-dezynfektorów i zapewnia osiągnięcie tego samego efektu użytkowego oraz technologicznego.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie urządzeń wyposażonych w kondensator oparów jako rozwiązania równoważnego względem wymaganego „Skraplacza ESS”.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni-dezynfektora wyposażonej w wydajny kondensator oparów opisany w pytaniu.

Pyt. 8

Część 6 - Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów – 1 szt.

Dot. pkt. 11 - Prosimy o podanie parametrów pary zasilającej w miejscu montażu w celu oceny możliwości użycia przyłącza parowego do zasilania urządzenia.

Odp.: Zamawiający nie oczekuje myjni-dezynfektora do Centralnej Sterylizacji, a jedynie małej myjni dezynfektora na Blok Operacyjny. W miejscu montażu Zamawiający nie posiada przyłącza do pary.

Pyt. 9

Część 6 - Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów – 1 szt.

Dot. pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie uruchamiane za pomocą przycisku umieszczonego na panelu sterowania, zamiast wymaganego systemu uruchamiania „bez użycia rąk”?

Wykonawca zwraca uwagę, że po załadowaniu wsadu i zamknięciu drzwi operator i tak jest zobowiązany do dokonania wyboru programu oraz potwierdzenia jego uruchomienia na panelu sterowania. W związku z powyższym wymaganie dodatkowego systemu uruchamiania „bez użycia rąk” nie wpływa na skuteczność procesu mycia i dezynfekcji, bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo personelu ani parametry eksploatacyjne urządzenia.

Jednocześnie rozwiązanie to nie jest wymagane przez normę PN-EN ISO 15883 i stanowi jedynie indywidualną cechę konstrukcyjną wybranych modeli myjni-dezynfektorów. W praktyce klinicznej uruchomienie programu przyciskiem na ekranie dotykowym lub panelu sterowania jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez wielu renomowanych producentów urządzeń.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie urządzeń uruchamianych za pomocą przycisku na panelu sterowania jako rozwiązania równoważnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie uruchamiane za pomocą przycisku umieszczonego na panelu sterowania.

Pyt. 10

Część 6 - Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów – 1 szt.

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

1. Dot. pkt. 4 - Prosimy o wyjaśnienie zapisu:

„Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134°C, czas ekspozycji 7 min., 121°C czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45°C, czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy”.

Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest myjnia-dezynfektor, która sama nie podlega procesom sterylizacji parowej ani plazmowej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, do jakiego elementu przedmiotu zamówienia odnosi się powyższy wymóg oraz jakie elementy Zamawiający przewiduje do demontażu i sterylizacji.

Obecne brzmienie wymagania uniemożliwia jednoznaczną ocenę jego zakresu oraz prawidłowe przygotowanie oferty.

Odp.: Zamawiający w załączniku nr 2.6 do SWZ Formularz właściwości techniczno – użytkowych Urządzenia objętego częścią 6 zamówienia w dziale II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU II. GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU – w związku z omyłką pisarską – wykreśla punkt 4.

Pyt. 11

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację w zakresie ograniczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych.

W związku z powyższym § 7 ust. 6 PPU otrzymuje brzmienie:

„6. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 30% wartości brutto Umowy. Odstąpienie od Umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania zapłaty kar umownych.”

Pyt. 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W razie zwłoki w przekazaniu Urządzenia do eksploatacji lub innych czynności Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust. 6 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto, niezrealizowanej części przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki.

Kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni Urządzenie zastępcze na czas naprawy (usunięcia wady) lub do wymiany Urządzenia na nowe.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację § 7 ust. 1 PPU:

W związku z powyższym § 7 ust. 1 projektowanych postanowień umownych (PPU) otrzymuje brzmienie:

„1.W razie zwłoki w przekazaniu Urządzenia do eksploatacji lub innych czynności Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie

określonym w § 5 ust. 6 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto, niezrealizowanej części przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki.

Kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni Urządzenie zastępcze na czas naprawy (usunięcia wady) lub do wymiany Urządzenia na nowe.”

Pyt. 13

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Urządzenia do eksploatacji lub innych czynności Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy przekraczającej 2 dni kalendarzowe Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 10 dni liczonych począwszy od dnia , w którym Zamawiający powziął informację o przyczynie odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia określonego niniejszym ustępem Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację postanowień projektu umowy i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 projektowanych postanowień umownych (PPU), uznając je za adekwatne do charakteru zamówienia oraz konieczne projektowanych postanowień umownych, uznając je za adekwatne do charakteru zamówienia oraz konieczne dla należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania.

Pyt. 14

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcą/Dostawcą/Sprzedawcą* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: _____.]

Odp.: Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zasad postępowania na wypadek awarii systemu KSeF, w tym możliwość czasowego wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (np. w formacie PDF), zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz komunikatami właściwego ministra.

W związku z powyższym § 4 ust. 2 PPU otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wszelkie faktury VAT i faktury korygujące dokumentujące transakcje objęte niniejszą Umową będą wystawiane i udostępniane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody

faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl”

Pyt. 15

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 1

3 zestawy do histeroskopii – płaszcz rozm.5 mm z kanałem roboczym 5 Fr kompatybilne z torem wizyjnym Olympus będącym w posiadaniu Zamawiającego

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający wymaga płaszcz o średnicy 5,5 mm z kanałem roboczym 5 Fr. Wymagana średnica płaszcz została określona z uwagi na oczekiwaną funkcjonalność zestawu, warunki przepływu medium podczas zabiegów oraz współpracę z wymaganym instrumentarium roboczym.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o potrzeby użytkowników oraz doświadczenia związane z wykonywaniem procedur histeroskopowych. Oferowane rozwiązanie o mniejszej średnicy płaszcz stanowi rozwiązanie odmienne konstrukcyjnie i nie zapewnia wymaganych przez Zamawiającego parametrów użytkowych.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzyma wymagania określone w OPZ.

Pyt. 16

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 2

Płaszcz, rozm. 5 mm, kanał roboczy 5 Fr., z ciągłym przepływem; kraniki rozbieralne pozwalające na bardzo dokładne umycie i konserwacje, łączenie z optyką poprzez mechanizm obrotowy

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wymagany płaszcz o średnicy 5,5 mm z kanałem roboczym 5 Fr, wyposażony w kraniki nierozbieralne oraz mechanizm zatraskowego mocowania optyki, został określony w oparciu o potrzeby użytkowników oraz doświadczenia eksploatacyjne Zamawiającego.

Kraniki nierozbieralne ograniczają liczbę elementów podlegających demontażowi i ponownemu montażowi po procesie mycia i sterylizacji, co minimalizuje ryzyko nieprawidłowego złożenia zestawu oraz usprawnia proces jego przygotowania do zabiegu. Jednocześnie mechanizm zatraskowy zapewnia szybkie, intuicyjne i pewne połączenie optyki z płaszczem, ograniczając możliwość niepełnego zamocowania elementów zestawu.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pyt. 17

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 3

Optyka histeroskopowa, średnica 2,9 mm, dł. rob. 30 mm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji optyki oraz tuba ochronna

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez

konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wymagane parametry optyki zostały określone z uwzględnieniem współpracy z pozostałymi elementami zestawu oraz oczekiwanych parametrów użytkowych. Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletnego rozwiązania spełniającego wymagania techniczne określone w OPZ, dlatego podtrzymuje wymagane parametry optyki.

Pyt. 18

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 4

Światłowód w nieprzeziernej osłonie, średnica wiązki 2,5 mm, długość 230 cm

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym. Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Parametry światłowodu zostały określone w celu zapewnienia optymalnej współpracy z posiadanym torem wizyjnym oraz właściwej organizacji stanowiska zabiegowego. Wymagana długość światłowodu umożliwia swobodne rozmieszczenie elementów toru endoskopowego bez ograniczania ergonomii pracy operatora i personelu medycznego.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pyt. 19

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 5

Światłowód endoskopowy typ CF.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Załączniku nr 2.8. poz. 5 do SWZ.

Pyt. 20

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 6

Uszczelka kanału roboczego z otworem o śr. 0,8 mm, pakowana po 10 szt.

Zamawiający w formularzu wskazuje 3 zestawy po 18 szt. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania 3 zestawów po 20 szt.

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wymagana uszczelka została dobrana do stosowanego instrumentarium oraz parametrów pracy zestawu histeroskopowego. Zastosowanie uszczelki o większej średnicy otworu może wpływać na szczelność układu oraz warunki prowadzenia zabiegu.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pyt. 21

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 7

Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr., półgiętkie; bransze typu kulociąg, obie ruchome, przyłącze typu Luer - do mycia instrumentu.

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym Wymagane

parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wymagane kleszczyki chwytające typu „zęby myszy” zostały określone ze względu na ich właściwości robocze oraz skuteczność chwytu materiału tkankowego podczas procedur histeroskopowych. Oferowane kleszczyki typu kulociąg posiadają odmienną konstrukcję części roboczej i nie zapewniają tożsamej funkcjonalności klinicznej.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pyt. 22

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 8

Nożyczki rozm. 5 Fr., półgiętkie; jedna bransza ruchoma, ostre, przyłącze typu Luer do mycia instrumentu.

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym. Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wymóg automatycznego zamykania bransz został określony w celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzania instrumentu do kanału roboczego oraz ograniczenia ryzyka uszkodzenia elementów roboczych histeroskopu. Rozwiązanie to wpływa również na komfort i bezpieczeństwo użytkownika instrumentarium.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ

Pyt. 23

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 9

kleszczyki typu punch, tnące, rozm. 5 Fr, półgiętkie, jedna bransza pracująca, przyłączy typu Luer do mycia instrumentu.

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wymagane kleszczyki/nożyczki haczykowate zostały dobrane z uwagi na zakres wykonywanych procedur oraz oczekiwane funkcje preparacyjne i manipulacyjne. Oferowane kleszczyki typu punch stanowią instrument o odmiennej konstrukcji i przeznaczeniu, przez co nie mogą zostać uznane za rozwiązanie równoważne funkcjonalnie.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pyt. 24

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 10

Kleszczyki chwytające, rozm. 5 FR, półgiętkie, obie bransze pracujące, przyłączy typu Luer do mycia instrumentu

Odp.: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ) tj.: Opis przedmiotu zamówienia w Części nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii (Załącznik nr 2.8 do SWZ został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, doświadczenia eksploatacyjne oraz konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym systemem histeroskopowym i torem wizyjnym Wymagane parametry techniczne i użytkowe mają na celu zachowanie jednolitości eksploatowanego instrumentarium, bezpieczeństwa wykonywanych procedur, sprawności procesów

dekontaminacji oraz ciągłości pracy personelu medycznego. Zamawiający uznaje wskazane parametry za uzasadnione swoimi potrzebami i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Zamawiający posiada tor wizyjny marki Olympus wykorzystywany do wykonywania procedur histeroskopowych. Wymagane parametry zestawu wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej, optycznej i eksploatacyjnej z posiadanym wyposażeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu adapterów, elementów pośrednich lub dodatkowych akcesoriów.

Po analizie przedstawionych w pytaniu propozycji Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wymagane kleszczyki miseczkowe typu „zęby rekina” zostały określone ze względu na ich zdolność do pewnego chwytu i utrzymania materiału tkankowego podczas zabiegu. Oferowane rozwiązanie posiada odmienną konstrukcję części roboczej, co przekłada się na inne właściwości użytkowe i nie zapewnia oczekiwanej funkcjonalności.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pyt. 25

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Dot. FORMULARZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie zamówień publicznych oraz w celu zachowania konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym zestawu o poniższych parametrach:

Poz. 12

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, z pokrywą, matą silikonową, kołkami i paskami do przymocowania instrumentów. Wymiary pojemnika 525 x 240 x 70 mm

W przypadku odmowy, prosimy o podanie uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem funkcjonalności w zakresie sterylizacji, transportu oraz przechowywania instrumentarium.

Pyt 26

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 8 niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, Rozporządzeniu MDR obowiązkowi oznakowania znakiem CE ani innym specjalnym wymogom posiadania atestów, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Wyroby te Spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i przeznaczone są przez producenta do pracy w środowisku bloku operacyjnego/sali operacyjnej, nie mają one bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 27

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi w j. polskim lub w j. angielskim wraz z tłumaczeniem na j. polski.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych Art. 12 ust. 4 dopuszcza się, aby wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników nie będących profesjonalistami posiadał etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim. Wykonawca będący dystrybutorem nie jest upoważniony do przygotowania polskiej wersji instrukcji lub jej tłumaczenia na j. polski.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 28

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Czy w związku z ogólnoswiatową mobilizacją do ochrony środowiska naturalnego nie tylko dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, ale także dla przetrwania przyszłych pokoleń, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do dostawy instrukcji w wersji papierowej i tym samym wyrazi zgodę na dostaczenie instrukcji obsługi tylko w wersji elektronicznej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 29

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia tłumaczeń na język polski dokumentów dopuszczających do obrotu sporządzonych w wersji anglojęzycznej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 30

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych

Odp.: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji zgodnie z Załącznikiem nr 2.8 do SWZ - Formularz Właściwości Techniczno – Użytkowe Urządzenia objętego częścią 8 zamówienia oraz Załącznikiem nr 3 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy

Pyt 31

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wykonania napraw w siedzibie Zamawiającego z uwagi na fakt, że w siedzibie Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności związane z konserwacją i przeglądem technicznym sprzętu, a naprawy wykonywane są poprzez wymianę w centrum serwisowym producenta.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wykonania napraw w siedzibie Zamawiającego.

Pyt 32

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Czy zamiast DTR Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie Instrukcji obsługi oraz Instrukcji dekontaminacji / reprocessingu dla danego przedmiotu zamówienia?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 33

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji do 72h?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 34

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 10 dni roboczych?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 35

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie zabezpieczenia, dostępności części zamiennych do okresu 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu zmian.

Pyt 36

Dotyczy: Część nr 8 – dostawa zestawów do histeroskopii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości naliczonych kar umownych do 20%?

Odp.: § 7 ust. 6 PPU otrzymuje brzmienie:

„6. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 30% wartości brutto Umowy. Odstąpienie od Umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania zapłaty kar umownych.”

Pyt. 37

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w komorę sterylizacyjną prostokątną wykonaną ze stali nierdzewnej (SUS)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 38

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w drzwi komory sterylizacyjnej przesuwne poziomo, z napędem elektrycznym i bezdotykowym systemem otwierania (przełącznik nożny), zapewniające równoważną funkcjonalność – tj. otwieranie i zamykanie bez użycia rąk?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 39

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanej lampy UV monitorującej stężenie nadtlenu wodoru w komorze, wyposażone w równoważny system monitorowania parametrów cyklu opartego na czujnikach ciśnienia i temperatury?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu. System monitorujący ciśnienie i temperaturę nie jest równoważnym z systemem monitorującym stężenie nadtlenu wodoru. Stężenie nadtlenu wodoru w komorze jest parametrem krytycznym w procesie sterylizacji plazmowej i wymaga dodatkowego monitorowania.

Pyt. 40

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym czynnik sterylizujący (nadtlenek wodoru o stężeniu min. 58%) dostarczany jest w zbiorniku wielokrotnego użytku, umożliwiającym wykonanie ok. 40 cykli sterylizacyjnych z jednego zbiornika, zamiast w naboju o pojemności min. 54 ml?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 41

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym opakowanie z czynnikiem sterylizującym zabezpieczone jest w sposób inny niż technologia RFID, przy zachowaniu funkcji uniemożliwiającej zużycie przeterminowanego czynnika sterylizującego (np. zabezpieczenie programowe z kontrolą daty ważności)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 42

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym czynnik sterylizujący dostarczany jest w zbiorniku wielokrotnego użytku z systemem automatycznego, bezdotykowego dozowania, bez konieczności podwójnego zabezpieczenia zużytego pojemnika?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 43

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 cykle sterylizacji do wyboru o czasach:

- cykl szybki (Quick): 30 ± 5 minut,
- cykl standardowy (Standard): 40 ± 5 minut,
- cykl specjalny (Special): 50 ± 5 minut,

przeznaczone do sterylizacji wszystkich rodzajów narzędzi i urządzeń medycznych, w tym endoskopów sztywnych i giętkich?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu. Zamawiający wymaga dostarczenia sterylizatora plazmowego z min. 4 cyklami sterylizacji.

Pyt. 44

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nieposiadające odrębnego cyklu kontrolującego poprawność przygotowania wsadu, przy zachowaniu funkcji automatycznego usuwania wilgoci ze wsadu w fazie rozgrzewu komory (system szybkiego rozgrzewu i suszenia –

Rapid Warmup & Dry System)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 45

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym cykl sterylizacyjny składa się z jednej fazy generowania plazmy, przy zachowaniu skuteczności sterylizacji potwierdzonej zgodnością z normą EN ISO 14937 oraz poziomem SAL 10^{-6} ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 46

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 7" i rozdzielczości minimum 800 x 480 pikseli?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 47

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym pojemnik z czynnikiem sterylizującym umożliwi przeprowadzenie ok. 40 procesów (zamiast minimum 5 procesów) bez konieczności wymiany pojemnika?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 48

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym pojemnik z czynnikiem sterylizującym umożliwi przeprowadzenie ok. 40 cykli ekonomicznych (zamiast minimum 16 cykli) bez konieczności wymiany pojemnika?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 49

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w jednym trybie stężenia czynnika sterylizującego (58–59% H-O⁻), bez możliwości przełączania na tryb wysokiego stężenia (80–95% H-O⁻)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 50

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wymogu wskazania w instrukcji obsługi systemu robotycznego jako rekomendowanego do reprocessowania optyk robotycznych? Wymóg w obecnym brzmieniu prowadzi do wskazania jednego konkretnego producenta sterylizatorów, ponieważ tylko jeden produkt na rynku jest wymieniony w instrukcji obsługi systemu robotycznego konkretnego producenta.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu. Wg wiedzy Zamawiającego w instrukcji obsługi systemu robotycznego jest rekomendowanych kilka sterylizatorów plazmowych do reprocessowania optyk.

Pyt. 51

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające sterylizację optyk endoskopowych zgodnie z parametrami sterylizacji plazmowej określonymi w punkcie II tabeli (temperatura 45 °C, czas ekspozycji 28 minut), bez wymogu jednoczesnej sterylizacji co najmniej 2 optyk robotycznych w cyklu ekonomicznym?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 52

Załącznik nr 2.4, Część 4: Dostawa sterylizatora plazmowego

Działając w imieniu Wykonawcy, zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz modyfikację treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wbudowaną drukarkę termiczną po jednej stronie komory (stronie wyładowczej), z możliwością wydruku wszystkich parametrów cyklu wskazanych w pkt dotyczącym wydruku w języku polskim?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 53

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów Załącznika nr 2.7 (formularz asortymentowo cenowy dla części 7) w zakresie stosowanych jednostek miary „SZT.” oraz „KP L.”.

W formularzu występują pozycje, w których :

- jednostka „KPL.” została zastosowana przy opisie pojedynczego wyrobu o określonym jednym wymiarze,
- jednostka „SZT.” została zastosowana przy pozycjach nazwanych jako „zestaw”.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, cz y:

- „SZT.” oznacza pojedynczy element
 - „KPL.” oznacza komplet w ramach jednej pozycji (np. narzędzie składające się z kilku części ci),
- oraz jak należy rozumieć pojęcie „zestaw” użyte w nazwach poszczególnych pozycji oraz w nazwie części 7 zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie w celu zapewnienia prawidłowego i jednolitego przygotowania ofert przez wykonawców.

czy też

- Zamawiający oczekuje zestawu obejmującego więcej niż jeden element lub wariant w ramach tej pozycji.

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie sposobu rozumienia jednostki „KPL.” dla tych pozycji

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje: jednostka sztuk oznacza pojedynczy element, w ramach jednej pozycji, a jednostka komplet oznacza komplet w ramach jednej pozycji. Zamawiający doprecyzował ilości dla wszystkich pozycji korygując Załącznik nr 2.7 do SWZ tj. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Urządzenia objętego częścią 7 zamówienia. Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu narzędzi operacyjnych - stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej W załączeniu – „skorygowany Zał 2.7 Zestaw narzędzi operacyjnych stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej 14 2026 DZP”

Wszystkie pozycje i ich ilości określone w „skorygowanym_Załącznik_2.7_Zestaw narzędzi operacyjnych stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej_14_2026_DZP” dotyczą 1 zestawu narzędzi operacyjnych stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej.

Pyt. 54

(pakiet 4, POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU, pkt. 4)

Prosimy Zamawiającego o usunięcie w całości tego opisu, gdyż sterylizator plazmowy jest urządzeniem przeznaczonym do przeprowadzania procesu sterylizacji i nie podlega sterylizacji jako wyrób medyczny.

Odp.: Zamawiający w załączniku nr 2.4 do SWZ Formularz właściwości techniczno – użytkowych Urządzenia objętego częścią 4 zamówienia w dziale II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU II. GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU – w związku z omyłką pisarską – wykreśla punkt 4.

Pyt. 55

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu nr 3:

Wymiary urządzenia:

szerokość: maks. 730mm

wysokość: maks. 1900mm

głębokość: maks. 900mm

(+/- 20 mm)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne do wymaganego o wymiarach jak poniżej?

- Szerokość: z wyposażeniem opcjonalnym - przy zamontowanej półce na drukarkę: 780 mm

- Wysokość: 1760 mm

- Głębokość: 620 mm

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż szerokość naszego urządzenia bez drukarki wynosi 530 mm, natomiast drukarka może być umiejscowiona w dowolnym miejscu, co podnosi elastyczność przy wyborze miejsca na urządzenie na bloku operacyjnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 56

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie katalogu dystrybutora, w którym będą potwierdzone powyższe wymiary?

Odp.: Zamawiający dopuszcza załączenie katalogu opisanego w pytaniu.

Pyt. 57

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu nr 6

Obudowa wykonana ze stali AISI 304; aluminium malowane na kolor biały, z proszkiem antybakteryjnym hamującym rozwój mikroorganizmów, opracowanym w technologii jonów srebra.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne do wymaganego o parametrach jak poniżej?

Obudowa z wytrzymałej stali nierdzewnej/aluminium malowana farbą proszkową pozwalającą na skuteczną dezynfekcję urządzenia.

Obudowa wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej lub aluminium malowanego farbą proszkową, pozwalającą na skuteczną dezynfekcję urządzenia, jest rozwiązaniem równoważnym względem wymogu „Stal AISI 304 / aluminium malowane na kolor biały, z proszkiem antybakteryjnym hamującym rozwój mikroorganizmów, opracowanym w technologii jonów srebra.”

Kluczową funkcją jest zapewnienie trwałej, odpornej na korozję powierzchni, łatwej do mycia i dezynfekcji, co gwarantuje zachowanie wymaganych standardów higienicznych. Zarówno stal nierdzewna, jak i aluminium z powłoką proszkową spełniają te kryteria. Różnica w zastosowanej technologii malowania (z proszkiem antybakteryjnym w technologii jonów srebra lub antybakteryjną farbą proszkową) nie wpływa na skuteczność procesu dezynfekcji, ponieważ czystość mikrobiologiczną zapewnia każdorazowa procedura mycia i dezynfekcji zgodna z normami laboratoryjnymi, a nie sama powłoka. Tym samym obudowa z wytrzymałej stali nierdzewnej/aluminium malowanego proszkowo gwarantuje identyczny poziom bezpieczeństwa i higieny użytkowania, co spełnia kryterium równoważności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 58

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu nr 7

Wodoszczelne zamknięcie na wypadek wycieków i awarii pompy

Wnosimy o odstąpienie o wymogu wodoszczelnego zamknięcia oraz o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, które jest wyposażone w dedykowane zabezpieczenia przeciwko wyciekom, takie jak przyciski bezpieczeństwa oraz systemy czujników wykrywania formaliny. Eliminują one konieczność stosowania dodatkowo szczelnych obudów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wodoszczelnego zamknięcia.

Wymóg ten został określony ze względu na konieczność zapewnienia biernego zabezpieczenia przed wydostaniem się formaliny poza obszar urządzenia w przypadku wycieku, nieszczelności układu dozowania lub awarii pompy. Celem tego wymagania nie jest jedynie wykrycie wycieku, lecz ograniczenie jego skutków poprzez zatrzymanie substancji chemicznej wewnątrz urządzenia i niedopuszczenie do jej dalszego rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu.

Zamawiający wskazuje, że przyciski bezpieczeństwa oraz czujniki wykrywania formaliny pełnią inną funkcję niż wodoszczelne zamknięcie. Czujniki i alarmy umożliwiają wykrycie nieprawidłowości oraz uruchomienie reakcji systemu, natomiast nie stanowią fizycznej bariery zapobiegającej wydostaniu się formaliny poza urządzenie. Podobnie przycisk bezpieczeństwa pozwala na zatrzymanie pracy urządzenia, ale nie zabezpiecza miejsca wycieku przed dalszym rozlaniem substancji.

Z uwagi na charakter formaliny oraz konieczność ochrony personelu i środowiska pracy Zamawiający wymaga jednoczesnego zastosowania rozwiązań detekcyjnych oraz konstrukcyjnych zabezpieczeń ograniczających skutki ewentualnego wycieku. Rozwiązania te nie są wobec siebie zamienne, lecz uzupełniają się w ramach wielostopniowego systemu bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w SWZ.

Pyt. 59

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu nr 10**

Dział: „System ładowania / dozowania formaliny”

„W fazie dozowania utrwalacza drzwi komory są zaryglowane, uniemożliwiając tym samym przypadkowe ich otwarcie przez personel”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne do wymaganego o parametrach jak poniżej?

„W fazie dozowania utrwalacza drzwi komory są zamknięte na magnetyczny zatrask drzwi zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem”

Magnetyczny zatrask drzwi zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem to rozwiązanie bezpieczniejsze, prostsze i bardziej ergonomiczne niż ryglowane drzwi. Zapewnia on skuteczną ochronę przed przypadkowym otwarciem komory, a jednocześnie pozwala na szybki dostęp w sytuacjach awaryjnych, minimalizując ryzyko związane z awarią mechanizmu ryglującego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby w fazie dozowania utrwalacza drzwi komory były zaryglowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe otwarcie przez personel. Wymóg ten został określony z uwagi na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika w czasie dozowania formaliny, w szczególności ograniczenia ryzyka ekspozycji personelu na substancję chemiczną oraz jej opary.

Zaproponowany przez Wykonawcę magnetyczny zatrask drzwi może stanowić rozwiązanie zabezpieczające przed samoczynnym lub przypadkowym uchyleniem drzwi, jednak nie jest rozwiązaniem równoważnym wobec mechanizmu ryglowania, którego celem jest faktyczne uniemożliwienie otwarcia komory w trakcie procesu dozowania. Zatrask magnetyczny ogranicza możliwość otwarcia drzwi, ale jej nie eliminuje, podczas gdy wymaganie Zamawiającego dotyczy blokady komory w czasie pracy urządzenia.

Zamawiający jako podmiot odpowiedzialny za organizację pracy oraz bezpieczeństwo personelu, określa poziom bezpieczeństwa wymagany dla urządzenia. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie równoważne i wykazać jego równoważność, jednak nie może zastępować oceny potrzeb Zamawiającego własną oceną, że inne rozwiązanie jest „bezpieczniejsze”, „prostsze” lub „bardziej ergonomiczne”, jeżeli nie zapewnia ono tego samego efektu funkcjonalnego wymaganego w SWZ.

Pyt. 60

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu nr 11 i 12:**

Dział : System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 11

„Podwójna wentylacja (jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze przestrzeni na odczynniki”)

Oraz

Punkt 12

„Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne do wymaganych o parametrach jak poniżej?

Jeden wydajny system filtracji oparów formalinowych dla komory dozowania oraz komory pojemnika z formaliną, który w trybie ciągłym odprowadza opary formalinowe podczas pracy, z możliwością regulacji czasu pracy wentylatora już po zakończonym procesie dozowania

formaliny. Rozwiązanie umożliwiające ograniczenie narażenia użytkownika na formalinę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024).

Zaproponowane rozwiązanie (jeden wydajny system filtracji oparów formalinowych) jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo Jeden wydajny układ to mniejsza emisja hałasu, prostszy serwis (jeden zestaw filtrów do kontroli) i mniejsze ryzyko awarii mechanicznej, przy zachowaniu tej samej (lub wyższej) wydajności przepływu powietrza.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania podwójnej wentylacji, tj. jednej w obszarze dozowania i jednej w obszarze przestrzeni na odczynniki, oraz dodatkowej wentylacji umieszczonej w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika.

Wymóg ten został określony z uwagi na konieczność zapewnienia miejscowego i wielostrefowego ograniczania oparów formaliny w obszarach, w których ryzyko ich powstania jest największe. Obszar dozowania oraz przestrzeń przechowywania odczynników stanowią odrębne strefy ryzyka, w których opary formaliny mogą pojawiać się w różnych momentach pracy urządzenia, w szczególności podczas napełniania pojemnika, wymiany zbiorników, otwarcia komory lub wystąpienia nieszczelności.

Zaproponowany przez Wykonawcę jeden wspólny system filtracji może stanowić rozwiązanie ograniczające emisję oparów, jednak nie zapewnia tego samego efektu funkcjonalnego, którego wymaga Zamawiający. Zamawiający wymaga nie tylko ogólnego odprowadzania oparów z urządzenia, lecz także miejscowej kontroli każdej ze stref ryzyka oraz dodatkowego zabezpieczenia obszaru dozowania w fazie napełniania pojemnika, czyli w fazie szczególnie istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa personelu.

Pyt. 61

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu 13 i 14

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 13:

„Szuflada w części przedniej zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze (punkt 13)

Oraz

Punkt 14:

„Przestrzeń szuflady dostępna dla min. 4 zbiorników (min. 10l. każdy)” (punkt 14)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne do wymaganych o parametrach jak poniżej?

„Zamykana szafka, w której umieszczona jest wysuwana szuflada zamontowana na prowadnicach zapewniająca łatwy dostęp do jednego zbiornika z utrwalaczem o pojemności 20 litrów”

W praktyce laboratoryjnej i medycznej stosowany jest jeden rodzaj utrwalacza – formalina. Pojedynczy zbiornik w pełni realizuje funkcjonalność proponowanego systemu i wystarcza do bezpiecznego i zgodnego z procedurami przechowywania oraz dozowania utrwalacza. Zarówno w przypadku jednego, jak i wielu zbiorników, konstrukcja urządzenia umożliwia dostęp od frontu, co jest kluczowym kryterium ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Nie ma realnej potrzeby stosowania wielu rodzajów utrwalaczy równolegle, ponieważ w zdecydowanej większości placówek w Polsce stosuje się wyłącznie 10% zbuforowaną formalinę jako podstawowy utrwalacz co jest standardem w histopatologii. Dodatkowo 10% roztwór buforowanej formaliny jest jedynym utrwalaczem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Patologów także funkcjonalność polegająca na możliwości umieszczenia w urządzeniu pojemników z

innymi rodzajami utrwalaczy nie jest wartością dodaną podczas rutynowej bieżącej pracy- co więcej generuje potencjalne ryzyko zalania materiału niewłaściwym utrwalaczem.

W nawiązaniu do powyższego zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisu dla punktu 13 w SWZ na:

„Szuflada w części przedniej zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze lub szuflada w części przedniej zapewniająca łatwy dostęp do zbiornika przechowującego utrwalacz.”

W nawiązaniu do powyższego zwracamy się również z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisu dla punktu 14 w SWZ na:

„Przestrzeń szuflady dostępna dla min. 4 zbiorników (min. 10l. każdy) lub przestrzeń szuflady dostępna dla jednego zbiornika na 10% roztwór buforowanej formaliny o pojemności 20 litrów bez konieczności stosowania różnego rodzaju utrwalaczy”

Odp.: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na modyfikację wymagania, jednak nie w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę.

Zamawiający wskazuje, że celem wymagania określonego w pkt 13 i 14 nie jest wyłącznie zapewnienie dostępu do zbiornika z utrwalaczem, lecz zapewnienie odpowiedniej pojemności roboczej odczynników dostępnych w urządzeniu, ograniczenie częstotliwości wymiany zbiorników oraz ograniczenie liczby czynności wykonywanych przez personel przy substancji chemicznej.

Wymaganie przestrzeni dla minimum 4 zbiorników po minimum 10 litrów odpowiada łącznej pojemności co najmniej 40 litrów. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie obejmujące jeden zbiornik o pojemności 20 litrów nie zapewnia równoważnego poziomu funkcjonalności, ponieważ oznacza dwukrotnie mniejszą pojemność roboczą. Różnica pomiędzy 20 litrami a 40 litrami jest istotna z punktu widzenia ciągłości pracy, organizacji procesu, częstotliwości wymiany zbiorników oraz ograniczania ekspozycji personelu na formalinę podczas czynności obsługowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na zastosowaniu innej liczby zbiorników niż 4, pod warunkiem że oferowane urządzenie zapewni możliwość umieszczenia w szufladzie lub zamykanej przestrzeni dostępnej od frontu jednego lub większej liczby zbiorników z utrwalaczem o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 litrów.

Zamawiający modyfikuje zapis następująco :

Pkt 13:

„Szuflada w części przedniej zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze lub zamykana szafka, w której umieszczona jest wysuwana szuflada zamontowana na prowadnicach zapewniająca łatwy dostęp do zbiornika lub zbiorników przechowujących utrwalacz.”

Pkt 14:

„Przestrzeń szuflady lub zamykanej szafki dostępnej od frontu urządzenia umożliwiająca umieszczenie zbiornika lub zbiorników z utrwalaczem o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 litrów.”

Pyt. 62

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu nr 15

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 15:

„Automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne do wymaganego o parametrach jak poniżej?

„Dedykowane wyżłobienia w podstawie komory zalewania dla każdej pojemności z obsługiwanych pojemników zapewniające prawidłowe ustawienia pojemnika względem dyszy dozującej w połączeniu z czujnikiem obecności pojemnika weryfikującym dodatkowo jego rozmiar oraz wysokość położenia dyszy”.

Zastosowane rozwiązanie w systemie do zalewania tkanek formaliną, polegające na wykorzystaniu dedykowanych wyżłobień w podstawie komory zalewania dla każdej pojemności obsługiwanych pojemników, zapewniających prawidłowe ustawienie pojemnika względem dyszy dozującej, w połączeniu z czujnikiem obecności weryfikującym dodatkowo jego rozmiar oraz wysokość położenia dyszy, należy uznać za rozwiązanie równoważne, a w aspekcie niezawodności nawet korzystniejsze, względem wymogu „automatycznego systemu centrowania pojemnika z czujnikiem obecności”. Nasze rozwiązanie zapewnia dodatkowo Wyżłobienia w podstawie komory stanowią dedykowane gniazda, które gwarantują stabilne i powtarzalne ustawienie pojemników względem dyszy dozującej, eliminując ryzyko przesunięć i błędnego centrowania. Funkcjonalnie odpowiada to zadaniu realizowanemu przez automatyczny system centrowania. Brak ruchomych elementów charakterystycznych dla systemów automatycznego centrowania ogranicza ryzyko awarii, upraszcza konserwację oraz ułatwia utrzymanie higieny w komorze zalewania.

Przedstawione rozwiązanie spełnia wszystkie funkcje wymagane przez zapis „automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności”, zapewniając równoważny poziom precyzji i bezpieczeństwa pracy.

Dodatkowo, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga funkcji automatycznego rozpoznawania objętości pojemnika.

Odp.: Tak, Zamawiający zgodę na urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że nie wymaga automatycznego rozpoznawania objętości pojemnika. Rozpoznanie, wybór albo weryfikacja rodzaju lub pojemności pojemnika może być realizowana przez każde rozwiązanie technologiczne przewidziane przez producenta urządzenia o ile zapewnia bezpieczne i prawidłowe przeprowadzenie procesu dozowania.

Pyt. 63

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu nr 16

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 16

Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza

Nasza wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza jest niezwykle dokładna. W związku z tym jej dokładność pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie utrwalacza : +/-20 g Mając powyższe na uwadze, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga takiej dokładności dozowania?

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Patologów są jednoznaczne i wskazują obowiązek utrwalania materiału tkankowego w stosunku 1:10 (stosunek masy tkanki do masy zastosowanego utrwalacza). Wyższa precyzja dozowania jest niezwykle ważnym atutem, jeśli chodzi o literalne stosowanie się do wytycznych PTP.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w SWZ, tj. wymóg posiadania wbudowanej wagi w komorze dozowania utrwalacza.

Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymagania dotyczącego dokładności dozowania na poziomie +/- 20 g. Wymagana waga ma zapewniać prawidłową kontrolę procesu dozowania utrwalacza, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia, dokumentacją producenta oraz procedurą pracy przewidzianą dla oferowanego systemu.

Pyt. 64

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu nr 17**

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 17

„Czujnik prawidłowego umieszczenia dozownika w pojemniku”

Wnosimy o usunięcie tego wymogu.

Oferowany przez nas system wykorzystuje rozwiązania konstrukcyjne, które w sposób fizyczny i jednoznaczny wymuszają prawidłowe umieszczenie dozownika. Wyżłobienia w podstawie komory stanowią dedykowane gniazda, które gwarantują stabilne i powtarzalne ustawienie pojemników względem dyszy dozującej, eliminując ryzyko przesunięć i błędnego centrowania oraz nieprawidłowego umieszczenia dozownika w pojemniku.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymagania.

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania czujnika prawidłowego umieszczenia dozownika w pojemniku. Wymóg ten został określony jako odrębne zabezpieczenie procesu dozowania formaliny i ma na celu potwierdzenie, że dozownik znajduje się we właściwym położeniu względem pojemnika przed rozpoczęciem lub w trakcie procesu dozowania.

Zamawiający wskazuje, że rozwiązania konstrukcyjne w postaci wyżłobień, gniazd lub przewodnic mogą wspierać prawidłowe ustawienie pojemnika, jednak nie zastępują aktywnej kontroli prawidłowego umieszczenia dozownika. Prawidłowe ustawienie pojemnika względem dyszy nie jest tożsame z potwierdzeniem, że dozownik został prawidłowo umieszczony w pojemniku i że proces dozowania może zostać bezpiecznie rozpoczęty.

Czujnik prawidłowego umieszczenia dozownika pełni funkcję niezależnego zabezpieczenia przed błędem użytkownika, niewłaściwym położeniem elementów roboczych, przesunięciem pojemnika, nieprawidłowym ustawieniem dozownika lub inną nieprawidłowością mogącą skutkować rozlaniem formaliny, emisją oparów albo narażeniem personelu na kontakt z substancją chemiczną.

Pyt. 65

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu nr 18**

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 18

„Czujnik pełnego pojemnika”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne zdecydowanie lepszemu do wymaganego o parametrach jak poniżej?

„Czujnik kontroli pełnego pojemnika w oparciu o masę badanej tkanki histopatologicznej”

Czujnik pełnego pojemnika w oparciu o masę badanej tkanki histopatologicznej to rozwiązanie bardziej precyzyjne, bezpieczne i zgodne z zasadami patomorfologii niż prosty czujnik pełnego pojemnika. Umożliwia on optymalne dozowanie utrwalacza, eliminuje ryzyko przelania, zmniejsza zużycie formaliny oraz ogranicza narażenie personelu.

Im większa dokładność tym lepsze utwalenie tkanki histopatologicznej, ponieważ ilość utrwalacza jest dostosowana do rzeczywistej masy próbki w sposób bliższy zaleceniom (stosunek tkanka: formalina 1:10). Wysoka dokładność ogranicza ryzyko błędów diagnostycznych wynikających z niedostatecznego lub nadmiernego zanurzenia próbki. Zapewnia większą powtarzalność i standaryzację procesu, co jest kluczowe z punktu widzenia jakości badań histopatologicznych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania jako równoważnego. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania czujnika pełnego pojemnika. Wymóg ten został określony jako niezależne zabezpieczenie przed fizycznym przepełnieniem pojemnika podczas procesu dozowania formaliny.

Zamawiający wskazuje, że kontrola ilości dozowanej formaliny w oparciu o masę materiału tkankowego może wspierać prawidłowe dozowanie utrwalacza i może stanowić dodatkową funkcjonalność urządzenia. Nie zastępuje jednak czujnika pełnego pojemnika, którego zadaniem jest wykrycie rzeczywistego stanu napełnienia pojemnika i zabezpieczenie procesu przed przepełnieniem, niezależnie od wyliczeń algorytmu, wskazań wagi, rodzaju pojemnika, masy próbki lub danych wprowadzonych

Pyt. 66

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu nr 19**

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 19

„Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do wymaganego o parametrach jak poniżej?

„Funkcja zastosowania ruchu wstrząsającego po zakończonym procesie dozowania”

Oferowana funkcja zastosowania ruchu wstrząsającego po zakończonym procesie dozowania stanowi rozwiązanie równoważne wobec wymogu zastosowania zaworu zapobiegającego kapaniu z dyszy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zawór zapobiegający kapaniu z dyszy albo inne równoważne rozwiązanie technologiczne producenta, w tym rozwiązanie polegające na zastosowaniu ruchu wstrząsającego po zakończonym procesie dozowania, pod warunkiem że wykonawca wykaże, iż oferowane rozwiązanie skutecznie zapobiega kapaniu formaliny z dyszy, nie powoduje rozprysku cieczy, nie zwiększa ryzyka emisji oparów formaliny oraz zapewnia nie niższy poziom bezpieczeństwa personelu i czystości komory roboczej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt 19 w następujący sposób:

„Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy albo inne równoważne rozwiązanie technologiczne producenta, skutecznie ograniczające ryzyko kapania formaliny z dyszy po zakończeniu procesu dozowania, bez powodowania rozprysku cieczy lub zwiększenia ryzyka emisji oparów formaliny.”

Pyt. 67

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu nr 20**

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 20

„Czujniki do kontroli wycieku odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do wymaganego o parametrach jak poniżej:

„Czujniki do wykrywania wycieków formalinowych, jeden w komorze zalewania pojemników z materiałem tkankowym oraz jeden w komorze z zasobnikiem formaliny”

Zaproponowane rozwiązanie należy uznać za równoważne względem wymagania „czujniki do kontroli wycieku odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy”.

W obu przypadkach detekcja obejmuje miejsca największego ryzyka powstania nieszczelności, a więc gwarantuje identyczny poziom bezpieczeństwa i ochrony użytkownika oraz środowiska pracy.

Odp.: Zamawiający częściowo dopuszcza rozwiązanie równoważne, jednak nie w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Zamawiający wyjaśnia, że celem wymagania określonego w pkt 20 SWZ jest zapewnienie skutecznej detekcji wycieku formaliny w miejscach, w których ryzyko jego wystąpienia jest

największe, tj. w komorze roboczej oraz w obszarze elementów układu dozowania, w szczególności pompy, przewodów i połączeń roboczych.

Zamawiający wskazuje, że komora z zasobnikiem formaliny nie zawsze jest tożsama z obszarem pompy. Detekcja wycieku w przestrzeni przechowywania zbiornika z formaliną może stanowić istotne zabezpieczenie, jednak nie zastępuje kontroli obszaru pompy, jeżeli pompa, przewody lub połączenia układu dozowania znajdują się w innej części urządzenia. Obszar pompy jest miejscem szczególnie istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ w tym miejscu mogą występować nieszczelności wynikające z pracy elementów mechanicznych, połączeń układu tłoczenia lub awarii pompy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na innym rozmieszczeniu czujników wycieku, pod warunkiem że wykonawca wykaże, iż oferowane rozwiązanie zapewnia skuteczną detekcję wycieku formaliny zarówno w komorze roboczej, jak i w obszarze pompy lub układu dozowania formaliny, obejmującym pompę, przewody i połączenia, w których może dojść do nieszczelności.

Pyt. 68

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu nr 21

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 21

„Procedura „tryb bezpieczeństwa” w przypadku wycieków wewnętrznych”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do wymaganego o parametrach jak poniżej:

„Automatyczny blokujący system czujników i powiązanych z nimi alarmów wraz z przyciskiem bezpieczeństwa umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie urządzenia w sytuacji zagrażającej operatorowi. Aktywacja przycisku bezpieczeństwa jako DODATKOWE zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym włączeniem bez wykonania procedury bezpiecznego restartu.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Pyt. 69

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu nr 22

Dział: System ładowania / dozowania formaliny

Punkt 22

Wbudowana lampa bakteriobójcza UVC z cyklem ręcznym i automatycznym, działająca w min. trzech trybach 15 min, 30 min oraz 45 min

Wnosimy o usunięcie tego wymogu.

Wymóg wyposażenia urządzenia do dozowania formaliny we „wbudowaną lampę bakteriobójczą UVC z cyklem ręcznym i automatycznym w minimum trzech trybach” jest nieadekwatny do charakteru urządzenia, nieuzasadniony funkcjonalnie. Formalina sama w sobie spełnia funkcję bakteriobójczą co przekłada się bezpośrednio na brak konieczności stosowania lampy UV. Jeżeli chodzi natomiast o samą zewnętrzną powierzchnię pojemników- krótki czas ekspozycji na promieniowanie UV nie uzasadnia użycia lampy i czyni takie rozwiązanie nadmiarowym.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia urządzenia we wbudowaną lampę bakteriobójczą UVC z cyklem ręcznym i automatycznym,.

Zamawiający wskazuje, że formalina pełni funkcję utrwalacza i może wykazywać działanie bakteriobójcze w pojemniku, w którym się znajduje. Nie oznacza to jednak, że formalina zastępuje system dekontaminacji obszaru roboczego urządzenia. Działanie formaliny odnosi się do materiału znajdującego się w pojemniku i objętego procesem utrwalania, a nie do powierzchni

komory roboczej, elementów urządzenia, obszaru pracy ani zewnętrznych powierzchni pojemników.

Zamawiający nie może przyjąć założenia, że formalina będzie pełniła funkcję środka dezynfekującego poza pojemnikiem, do którego jest dozowana. Ewentualna obecność formaliny poza pojemnikiem mogłaby wystąpić wyłącznie w przypadku nieszczelności, rozlania lub nieprawidłowego działania urządzenia, co z punktu widzenia Zamawiającego jest sytuacją niedopuszczalną i stanowi ryzyko dla personelu oraz środowiska pracy. Nie można zatem uzasadniać rezygnacji z lampy UVC twierdzeniem, że formalina sama w sobie działa bakteriobójczo, skoro formalina powinna znajdować się wyłącznie w zamkniętym pojemniku i szczelnym układzie dozowania.

Wymóg lampy UVC został określony ze względu na planowane użytkowanie urządzenia w warunkach szpitalnych, w szczególności na Bloku Operacyjnym, przy materiale biologicznym i histopatologicznym. W takim środowisku Zamawiający wymaga podwyższonego reżimu sanitarnego oraz dodatkowego rozwiązania ograniczającego ryzyko mikrobiologiczne w obszarze roboczym urządzenia. Lampa UVC stanowi element profilaktyki sanitarnej i dekontaminacji komory roboczej, niezależny od działania formaliny jako utrwalacza.

Zamawiający podkreśla, że celem wymagania nie jest dezynfekcja formaliny ani zastąpienie procedur mycia i dezynfekcji, lecz zapewnienie dodatkowego, wbudowanego mechanizmu ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w urządzeniu stosowanym w środowisku o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Tryb ręczny i automatyczny pozwalają dostosować cykl do organizacji pracy, intensywności użytkowania urządzenia oraz procedur obowiązujących u Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje wymaganie za związane z przedmiotem zamówienia, proporcjonalne do celu zamówienia oraz uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i organizacyjnego w warunkach szpitalnych.

Pyt. 70

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu nr 24**

Dział: System filtracji oparów formaliny

Punkt 24

„Filtr z węglem aktywnym (z jednym lub dwoma wkładami) o łącznej masie min. 25 kg”.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne względem wymogu:

System filtracji obejmujący filtr wstępny oraz filtr węglowy dedykowany do oparów formalinowych.

Pragniemy wskazać, iż określenie minimalnej masy węgla aktywnego na poziomie 25 kg nie stanowi jedyne ani obiektywne wyznacznika skuteczności filtracji oparów formaliny. Kluczowe znaczenie mają w szczególności:

Oferowany przez nas filtr węglowy jest rozwiązaniem dedykowanym do oparów formalinowych, co zapewnia wysoką skuteczność adsorpcji formaldehydu przy jednoczesnej optymalizacji ilości zastosowanego materiału filtracyjnego. Dodatkowo zastosowanie filtra wstępnego wydłuża żywotność filtra właściwego oraz zwiększa efektywność całego układu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania w opisanym zakresie.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące filtra z węglem aktywnym o łącznej masie minimum 25 kg. Wymóg ten został określony ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej pojemności sorpcyjnej systemu filtracji, skutecznego ograniczenia emisji oparów formaliny oraz odpowiedniej żywotności eksploatacyjnej filtra w warunkach pracy szpitalnej.

W szczególności Wykonawca nie wskazał, czym jest deklarowany filtr wstępny, jaką posiada klasę lub charakterystykę filtracji, jakie zanieczyszczenia zatrzymuje, w jakim zakresie wspiera

pracę filtra węglowego oraz jaki ma wpływ na skuteczność i żywotność całego układu filtracji. Brak jest również danych dotyczących rodzaju zastosowanego węgla aktywnego, jego masy, pojemności sorpcyjnej, skuteczności adsorpcji formaldehydu, wydajności przepływu powietrza, warunków badania, przewidywanego czasu pracy filtra do nasycenia oraz dokumentów potwierdzających zachowanie skuteczności filtracji w warunkach odpowiadających pracy urządzenia u Zamawiającego.

Pyt. 71

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu nr 27 :

Dział: Terminal z ekranem dotykowym

Punkt 27

- Rozdzielczość min 1280x800,

Zamawiający w treści SWZ określił wymóg dotyczący rozdzielczości panelu operatorskiego na poziomie 1280 × 800

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne panel operatorski o rozdzielczości **1024 × 600**?

Wskazanie konkretnej rozdzielczości ekranu (1280 × 800) nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego ani technologicznego w kontekście systemu dozowania formaliny i może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji.

Rozdzielczość ekranu nie stanowi parametru determinującego funkcjonalność systemu, ponieważ:

- interfejs operatorski w tego typu urządzeniach prezentuje ograniczoną liczbę parametrów (objętość dozowania, status pracy, alarmy),
- kluczowe znaczenie ma ergonomia, logika interfejsu oraz czytelność komunikatów, a nie liczba pikseli,
- rozdzielczość 1024 × 600 przy ekranie 10" zapewnia w pełni wystarczającą czytelność i komfort pracy operatora,
- wszystkie wymagane funkcje systemu (wizualizacja, sterowanie, komunikaty bezpieczeństwa) są realizowane w sposób równoważny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Pyt. 72

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu nr 31:

Dział: Terminal z ekranem dotykowym:

Punkt 31

System operacyjny min. Windows 10

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o parametrach jak poniżej?

System sterowania PLC

Systemy oparte na sterownikach PLC są standardowo stosowane w aplikacjach przemysłowych, zapewniając wysoką niezawodność, deterministyczność działania oraz stabilność pracy ciągłej. Brak konieczności stosowania systemu operacyjnego typu Windows nie wpływa na funkcjonalność systemu, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo i odporność na zakłócenia.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wskazanego rozwiązania jako równoważnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Pyt. 73

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu 36

Dział: Dostępne wejścia/wyjścia

Punkt 36

Zintegrowany czytnik kart do systemu monitorowania temperatury

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia z zintegrowanymi czytnikami kart do systemu monitorowania temperatury?

Funkcjonalność ta nie jest kluczowa dla podstawowego działania systemu bezkontaktowego dozowania formaliny, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa operatora oraz precyzyjne dozowanie odczynnika. Rejestracja oraz kontrola temperatury mogą być kluczowa poza system w czasie przechowywania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz późniejszego jego transportu.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu opisane w pytaniu.

Pyt. 74

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu 37**

Dział: Drukarka do drukowania etykiet i czytnik kodów kreskowych

Punkt 37

drukarka wbudowana w bryłę urządzenia

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do wymaganego o parametrach jak poniżej:

Zewnętrzna drukarka etykiet

Zamiast drukarki wbudowanej proponujemy zewnętrzną drukarkę etykiet. Rozwiązanie to jest bardziej uniwersalne w konfiguracji urządzenia na bloku operacyjnym, ponieważ drukarkę można ustawić w dogodnym miejscu, dostosowując stanowisko pracy do potrzeb personelu i dostępnej powierzchni, a jednocześnie zachowując trwałość eksploatacyjną.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby drukarka była wbudowana w bryłę urządzenia. Wymóg ten został określony ze względu na potrzebę zapewnienia zwartego, kompletnego i łatwego do utrzymania w czystości stanowiska pracy, przeznaczonego do użytkowania w warunkach szpitalnych, w szczególności na Bloku Operacyjnym.

Zamawiający wskazuje, że drukarka zewnętrzna stanowi dodatkowy element wyposażenia stanowiska, wymagający odrębnego miejsca ustawienia, dodatkowego okablowania lub połączeń oraz dodatkowej powierzchni podlegającej czyszczeniu i dezynfekcji. W warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego rozwiązanie wbudowane ogranicza liczbę elementów zewnętrznych wokół urządzenia, ułatwia utrzymanie porządku i czystości stanowiska oraz zmniejsza ryzyko przypadkowego przemieszczenia drukarki, zabrudzenia przewodów lub rozdzielenia procesu dozowania od procesu etykietowania.

Wbudowana drukarka zapewnia również jednoznaczne powiązanie procesu dozowania formaliny z bezpośrednim wydrukiem etykiety przy urządzeniu, co ogranicza ryzyko omyłek organizacyjnych i wspiera identyfikowalność próbek. Dla Zamawiającego istotne jest, aby urządzenie było kompletne i gotowe do pracy bez konieczności organizowania dodatkowego stanowiska dla drukarki zewnętrznej.

Argument Wykonawcy dotyczący większej elastyczności ustawienia drukarki nie przesądza o równoważności rozwiązania. Zamawiający, jako podmiot odpowiedzialny za organizację pracy i bezpieczeństwo sanitarne stanowiska, wymaga rozwiązania integralnego, ograniczającego liczbę elementów zewnętrznych w bezpośrednim otoczeniu urządzenia.

Pyt. 75

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu 38**

Dział: Drukarka do drukowania etykiet i czytnik kodów kreskowych

Punkt 38

Korpus z tworzywa ABS z przednią pokrywą

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o parametrach jak poniżej?

Korpus z tworzywa ABS z górną pokrywą

Tak precyzyjne wymagania, dotyczące nieistotnych z punktu widzenia działania systemu detali konstrukcyjnych, prowadzą do sztucznego mnożenia parametrów technicznych, które nie wpływają na jakość, niezawodność ani funkcjonalność urządzenia w zastosowaniu przemysłowym.

Utrzymanie tak szczegółowego wymagania może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji poprzez preferowanie konkretnych modeli urządzeń, zamiast dopuszczenia szerokiej gamy rozwiązań spełniających te same funkcje użytkowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie pkt 38

Zamawiający wyjaśnia, że celem wymagania określonego w pkt 38 SWZ jest zapewnienie trwałej, odpornej i łatwej w użytkowaniu konstrukcji drukarki, umożliwiającej prawidłową eksploatację urządzenia, w tym dostęp do materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymanie drukarki w należyłym stanie technicznym i sanitarnym.

Zamawiający dopuszcza korpus z tworzywa ABS z górną pokrywą, pod warunkiem że rozwiązanie to zapewnia nie niższą funkcjonalność, trwałość, ergonomię obsługi oraz możliwość prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji niż rozwiązanie pierwotnie opisane w SWZ.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że dopuszczenie górnej pokrywy w drukarce nie oznacza dopuszczenia drukarki zewnętrznej. Wymaganie określone w pkt 37 SWZ pozostaje bez zmian, tj. drukarka nadal musi być wbudowana w bryłę urządzenia.

Pyt. 76

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu 42

Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z oferowanym urządzeniem

Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych kompatybilne z urządzeniem:

Punkt 42

Pojemniki dedykowane do urządzenia o pojemnościach:

0,5L, transparentny (120 szt. w opakowaniu zbiorczym)

1L, transparentny (120 szt. w opakowaniu zbiorczym)

3L, transparentny (40 szt. w opakowaniu zbiorczym)

5L, transparentny (25 szt. w opakowaniu zbiorczym)

10L, nietransparentny (12szt. w opakowaniu zbiorczym)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rozwiązania zdecydowanie lepszego od wymaganego o parametrach jak poniżej?

„Pojemniki nietransparentne 0,25/0,5/1/3/5/11 litrów”

- pojemnik nietransparentny 0,25L – 120 szt.

- pojemnik nietransparentny 0,5L – 120 szt

- pojemnik nietransparentny 1L – 120 szt

- pojemnik nietransparentny 3L – 40 szt

- pojemnik nietransparentny 5L – 25 szt

- pojemnik nietransparentny 11L – 12 szt.

Możliwość korzystania z sześciu pojemników o pojemnościach 250 ml, 0,5l, 1l, 3l, 5l i aż 11l jest rozwiązaniem bardziej elastycznym, bezpiecznym i ergonomicznie korzystnym niż zestaw wymagany 5 pojemników w zakresie od 0,5 L do 10 L.

Zaproponowany przez nas zestaw pozwala na precyzyjne dozowanie dla próbek małych i dużych oraz ułatwia pracę i zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Pojemniki 0,5 L mają większą średnicę dna, w związku z czym mniejszy materiał tkankowy przy ilości zalanej formaliny w stosunku 1:10 bardzo często nie jest pokrywany w pełni formaliną, co z oczywistych powodów jest dysfunkcyjne oraz nie spełnia wymogów standaryzacji procesu w przypadku niektórych tkanek. Zastosowanie dodatkowego pojemnika 0,25L eliminuje ten problem. Z kolei nasz pojemnik o pojemności 11L również z oczywistych względów poszerza zakres wagowy obsługiwane materiału tkankowego bardziej niż pojemnik 10L. Dodatkowo Zamawiający ma pełną dowolność, jeżeli chodzi o ilość zamawianych pojemników. (nie posiadamy opakowań zbiorczych).

Jednocześnie transparentność pojemników nie stanowi koniecznego parametru funkcjonalnego dla prawidłowego przechowywania materiału histologicznego, a jego zasadność z punktu widzenia procesowego i użytkowego nie jest jednoznaczna. W wielu zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych stosuje się pojemniki nieprzezroczyste, **które zapewniają pełną ochronę materiału przed światłem oraz czynnikami zewnętrznymi.**

Jednocześnie tak precyzyjne wymaganie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji poprzez zawężenie dostępnych rozwiązań, mimo że inne konstrukcje pojemników spełniają te same wymagania w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Dodatkowa pojemność z **oczywistych względów** zwiększa możliwość standaryzacji procedur w zależności od rodzaju materiału histologicznego, co może poprawić standaryzację procesu i ergonomię pracy personelu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w pytaniu.

Pyt. 77

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu 43

**Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z oferowanym urządzeniem
Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych kompatybilne z urządzeniem:**

Punkt 43

„Pojemniki z widocznym oznaczeniem pojemności”

Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

Zapis „pojemniki z widocznym oznaczeniem pojemności” ogranicza konkurencyjność postępowania i nie ma istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa ani ergonomii pracy przy systemach bezpiecznego dozowania formaliny. W praktyce wymóg widocznego oznaczenia pojemności ma charakter estetyczny, a nie funkcjonalny. Z punktu widzenia użytkownika nie wpływa na dokładność pracy, trwałość systemu ani jakość dozowania. Dopuszczenie pojemników bez oznaczenia pojemności **pozwoli na zaoferowanie urządzeń nowocześniejszych, w których kontrola ilości dozowanego medium odbywa się elektronicznie, z większą precyzją i w pełni zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymagania.

Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby pojemniki posiadały widoczne oznaczenie pojemności.

Wymóg ten nie ma charakteru estetycznego, lecz funkcjonalny, organizacyjny i bezpieczeństwa.

Zamawiający wskazuje, że użytkownik musi mieć możliwość jednoznacznego i szybkiego ustalenia, jakiego pojemnika używa przed rozpoczęciem procesu dozowania formaliny. Widoczne oznaczenie pojemności pozwala personelowi zweryfikować, czy wybrany pojemnik (jego pojemność) odpowiada rodzajowi materiału, oczekiwanej ilości utrwalacza oraz procedurze pracy. Brak takiego oznaczenia mógłby prowadzić do omyłkowego użycia pojemnika o niewłaściwej pojemności.

Zamawiający nie podziela stanowiska, że elektroniczna kontrola ilości dozowanego medium zastępuje widoczne oznaczenie pojemności pojemnika. System elektroniczny może wspierać proces dozowania, jednak nie eliminuje potrzeby wzrokowej weryfikacji pojemnika przez użytkownika. Kontrola elektroniczna dotyczy pracy urządzenia, natomiast oznaczenie

pojemności na pojemniku umożliwi prawidłowy dobór pojemnika jeszcze przed rozpoczęciem procesu.

W warunkach szpitalnych, w szczególności przy pracy z materiałem biologicznym i formaliną, Zamawiający wymaga rozwiązań ograniczających ryzyko błędu użytkownika. Widoczne oznaczenie pojemności stanowi proste i niezależne zabezpieczenie organizacyjne, wspierające prawidłową identyfikację pojemnika, standaryzację pracy oraz bezpieczeństwo procesu.

Zamawiający dopuszcza dowolną technologię wykonania oznaczenia pojemności, pod warunkiem że oznaczenie jest widoczne, jednoznaczne i czytelne dla użytkownika przed użyciem pojemnika.

Pyt. 78

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

dotyczy punktu 44

Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z oferowanym urządzeniem

Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych kompatybilne z urządzeniem:

Punkt 44

„Pokrywy pojemników wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zdecydowanie lepsze do wymaganego o parametrach jak poniżej:

„Dedykowane pokrywy wyposażone w otwór technologiczny zamykany dedykowaną etykietą membranową.”

Oferowane rozwiązanie w postaci pokryw pojemników wyposażonych w otwór technologiczny zamykany dedykowaną etykietą membranową, stanowi rozwiązanie lepsze wobec zapisu wskazującego na konieczność stosowania zaworu jednokierunkowego ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym. Funkcjonalnym celem wymogu jest zapewnienie szczelności pojemnika, bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony przed przypadkowym wyciekiem lub emisją oparów. Funkcje te są w pełni realizowane przez zastosowanie etykiety membranowej, która skutecznie zamyka otwór technologiczny, gwarantując szczelność, zapewniając jej podwyższoną odporność mechaniczną na uszkodzenia. Rozwiązanie to upraszcza obsługę, eliminuje ryzyko awarii elementu mechanicznego, jakim jest zawór, a jednocześnie zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania jako równoważnego.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie, aby pokrywy pojemników były wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełniania pojemników formaliną.

Zamawiający wskazuje, że celem wymagania nie jest wyłącznie uzyskanie szczelności pojemnika po zakończeniu procesu, lecz zapewnienie bezpiecznego napełniania pojemnika formaliną w sposób ograniczający ryzyko wycieku, cofnięcia cieczy, emisji oparów oraz kontaktu personelu z formaliną w trakcie całego procesu.

Rozwiązanie polegające na zastosowaniu otworu technologicznego zamykanego dedykowaną etykietą membranową nie jest rozwiązaniem równoważnym wobec zaworu jednokierunkowego ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym. Etykieta membranowa może pełnić funkcję zamknięcia otworu po zakończeniu procesu napełniania, natomiast nie zapewnia tej samej funkcji co zawór jednokierunkowy w czasie napełniania pojemnika. W szczególności nie wykazano, aby takie rozwiązanie zapewniało jednokierunkowy przepływ formaliny, ograniczało ryzyko cofnięcia cieczy, zabezpieczało przed wyciekiem w trakcie dozowania oraz ograniczało emisję oparów formaliny na poziomie równoważnym do wymaganego w SWZ.

Zamawiający wskazuje również, że otwór technologiczny wymagający późniejszego zamknięcia etykietą membranową tworzy dodatkowy etap obsługi i dodatkowe ryzyko błędu użytkownika, w szczególności ryzyko niewłaściwego zamknięcia, niepełnego uszczelnienia, uszkodzenia etykiety, jej odklejenia albo opóźnienia zamknięcia pojemnika po napełnieniu. W przypadku pracy z formaliną Zamawiający wymaga rozwiązania ograniczającego takie ryzyko już na etapie napełniania pojemnika.

Argument Wykonawcy dotyczący prostszej konstrukcji i braku elementu mechanicznego nie przesądza o równoważności rozwiązania. Dla Zamawiającego istotne jest zapewnienie określonego efektu funkcjonalnego i bezpieczeństwa, tj. napełniania pojemnika przez rozwiązanie ograniczające możliwość wycieku, emisji oparów oraz niekontrolowanego kontaktu z formaliną.

Pyt. 79

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu 45**

Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z oferowanym urządzeniem

Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych kompatybilne z urządzeniem:

Punkt 45

„Pokrywy pojemników oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek”

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga rozwiązania lepszego od wymaganego o parametrach jak poniżej?

„Urządzenie automatycznie rozpoznaje objętość używanego pojemnika, bez konieczności identyfikacji tej informacji na podstawie niepowtarzalnego kodu kreskowego 2D umieszczonego na pokrywie pojemnika”

Oferowane rozwiązanie należy uznać za co najmniej równoważne, a w praktyce korzystniejsze od wymaganego, ponieważ eliminuje konieczność każdorazowego sczytywania kodu z pokrywy, upraszcza obsługę urządzenia oraz ogranicza ryzyko błędów wynikających z nieprawidłowego odczytu, uszkodzenia lub zabrudzenia kodu kreskowego. Automatyczne rozpoznawanie objętości pojemnika zapewnia ten sam efekt funkcjonalny, tj. prawidłową identyfikację stosowanego pojemnika, a jednocześnie zwiększa niezawodność i wygodę eksploatacji.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rozwiązania, w którym identyfikacja objętości pojemnika odbywa się automatycznie przez urządzenie, bez wykorzystania kodu kreskowego 2D na pokrywie, jako rozwiązanie lepsze od opisanego w SWZ?

W przypadku braku zgody prosimy o szczegółowe uzasadnienie, dlaczego Zamawiający wymaga identyfikacji pojemnika właśnie za pomocą kodu kreskowego 2D na pokrywie, skoro oferowane rozwiązanie realizuje ten sam cel funkcjonalny w sposób bardziej automatyczny i mniej podatny na błędy.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że celem wymagania określonego w pkt 45 SWZ jest zapewnienie prawidłowej identyfikacji pojemnika, rozpoznania jego pojemności oraz możliwości śledzenia próbki w procesie pracy urządzenia.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym rozpoznawanie pojemności pojemnika odbywa się automatycznie przez urządzenie, bez konieczności odczytu tej informacji z kodu kreskowego 2D umieszczonego na pokrywie pojemnika, pod warunkiem że rozwiązanie to zapewnia prawidłowe i powtarzalne rozpoznanie objętości używanego pojemnika oraz nie obniża bezpieczeństwa procesu dozowania.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że automatyczne rozpoznanie pojemności pojemnika nie zastępuje funkcji śledzenia próbki. Śledzenie próbki musi być zapewnione przez kod kreskowy

2D, inny kod identyfikacyjny albo równoważne rozwiązanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację pojemnika i powiązanie go z próbką.

Zamawiający dopuszcza zatem zarówno rozwiązanie oparte na kodzie kreskowym 2D umieszczonym na pokrywie pojemnika, jak i rozwiązanie, w którym urządzenie automatycznie rozpoznaje pojemność pojemnika, pod warunkiem zachowania funkcji śledzenia próbek oraz jednoznacznej identyfikacji pojemnika w procesie pracy.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt 45 w następujący sposób:

„Pokrywy pojemników oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek albo równoważne rozwiązanie, w którym urządzenie automatycznie rozpoznaje pojemność pojemnika, przy jednoczesnym zapewnieniu śledzenia próbek za pomocą kodu 2D, innego kodu identyfikacyjnego lub równoważnego systemu identyfikacji.”

Pyt. 80

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu 46

Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z urządzeniem:

Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych kompatybilne z urządzeniem

Punkt 46

„Pokrywy pojemników zgodnie z rozporządzeniem MDR wyposażone w kod UDI, zawierające następujące informacje:

- GTIN: numer pozycji w handlu globalnym,
- (10): partia, do której należy pojemnik,
- (240): kod katalogowy,
- (91): masa pustego pojemnika,
- (92): typ pojemnika,
- (93): wewnętrzne pole identyfikatora
- (94): identyfikator wiadra, niepowtarzalna wartość dla każdego wygenerowanego kodu”

Wnosimy o jego usunięcie jako nadmiernego i nieproporcjonalnego, a w jego miejsce proponujemy rozwiązanie równoważne:

„Pojemniki muszą być wyrobami medycznymi oznakowanymi w następujące informacje:

- numer pozycji w handlu globalnym,
- kod katalogowy,
- wewnętrzne pole identyfikatora,
- dane identyfikacyjne na etykiecie membranowej które są drukowane po zalaniu materiału tkankowego.”

Usunięcie nadmiernego wymogu dotyczącego umieszczania danych tylko i wyłącznie na pokrywie ogranicza uczciwą konkurencję w postępowaniu przetargowym

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisane w pytaniu.

Pyt. 81

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu 48

Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z urządzeniem:

Zbiornik z formaliną kompatybilny z urządzeniem

Punkt 48

Zbiornik wykonany z polietylenu (oznaczenie 04 PE- LD), wypełniony 10% zbuforowaną formaliną (formaldehyd 1%-5%, alkohol metylowy 0%- 0,5%) pH mieszczące się w zakresie 7.2-7.4 - zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Patologów potwierdzone wynikami z Laboratorium akredytowanego na terenie Polski

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego o parametrach techniczno-użytkowych jak poniżej:

„Dedykowany do urządzenia zbiornik z formaliną wypełniony 10% zbuforowaną formaliną o PH mieszczącym się w zakresie minimum od 7,2 do 7,4 (zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Patologów) – zbiornik wyposażony w szybkozłączce kompatybilne z automatycznym systemem. Kompatybilny z urządzeniem w załączeniu potwierdzenie producenta.’

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisane w pytaniu.

Pyt. 82

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu 54**

Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z urządzeniem:

Papier termiczny kompatybilny z urządzeniem

Punkt 54

Rolka papieru termicznego kompatybilna z drukarką urządzenia

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego o parametrach techniczno-użytkowych jak poniżej:

„Etykiety dedykowane do systemu odporne na działanie formaliny oraz wilgoci zapewniające całkowitą szczelność pojemnika z materiałem tkankowym wypełnionym formaliną podczas transportu rolka – 500 szt.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie pkt 54, pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych poniżej.

Zamawiający wyjaśnia, że celem wymagania określonego w pkt 54 SWZ jest zapewnienie materiału eksploatacyjnego kompatybilnego z drukarką urządzenia, umożliwiającego prawidłowe drukowanie oznaczeń wymaganych w procesie identyfikacji próbek.

Zamawiający dopuszcza etykiety dedykowane do oferowanego systemu, w tym etykiety w rolce, odporne na działanie formaliny oraz wilgoci, pod warunkiem że są one w pełni kompatybilne z drukarką urządzenia, zapewniają trwałą i czytelny nadruk oraz umożliwiają prawidłową identyfikację pojemnika i próbki.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że etykieta nie może być traktowana jako element zastępujący konstrukcyjne uszczelnienie pojemnika. Funkcją etykiety jest oznakowanie i identyfikacja próbki, natomiast szczelność pojemnika musi wynikać z konstrukcji pojemnika, pokrywy oraz zastosowanego systemu zamknięcia. Deklarowana odporność etykiety na formalinę i wilgoć może stanowić cechę korzystną, jednak nie zastępuje wymagań dotyczących szczelności pojemnika i pokrywy.

Pyt. 83

**Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny
dotyczy punktu 55**

Dział: Akcesoria oraz materiały eksploatacyjne kompatybilne z urządzeniem:

Papier termiczny kompatybilny z urządzeniem

„Ilości rolek papieru do dostarczenia wraz z urządzeniem: minimum 20 rolek”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego o parametrach techniczno-użytkowych jak poniżej:

Ilości rolek z etykietami dedykowanymi do systemu odporne na działanie formaliny oraz wilgoci zapewniające całkowitą szczelność pojemnika z materiałem tkankowym wypełnionym formaliną podczas transportu. Na etykietach generowane są nadruki z informacją o godzinie i dacie zalania materiału tkankowego formaliną oraz wadze próbki i formaliny, proporcji zalania i nr LOT

formaliny 1 rolka – 500 szt. etykiet”: minimum 3 rolki

Odp.: W przypadku zaferowania urządzenia wykorzystującego etykiety dedykowane do systemu zamiast papieru termicznego Zamawiający dopuszcza dostarczenie minimum 3 rolek etykiet, pod warunkiem że każda rolka zawiera minimum 500 etykiet, tj. łącznie minimum 1500 etykiet, oraz że etykiety są w pełni kompatybilne z drukarką urządzenia i zapewniają trwałą oraz czytelny nadruk odporny na warunki użytkowania przewidziane dla systemu.

Pyt. 84

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy punktu 4

GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Punkt 4:

Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134°C, czas ekspozycji 7 min., 121°C czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy

Wnosimy o usunięcie tego wymogu.

Uzasadnienie:

Wymóg dotyczący możliwości sterylizacji elementów urządzenia w określonych parametrach sterylizacji parowej lub plazmowej jest ponadmiarowy i nie pozostaje w bezpośrednim związku z podstawową funkcją systemu dozowania formaliny. Prawidłowe użytkowanie i bezpieczeństwo systemu mogą być zapewnione poprzez procedury mycia, dezynfekcji oraz dekontaminacji przewidziane przez producenta i potwierdzone dokumentacją wyrobu medycznego.

Jednocześnie wskazanie konkretnych metod, temperatur oraz czasów sterylizacji może nieuzasadnienie ograniczać krąg potencjalnych wykonawców oferujących rozwiązania równoważne, które spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kontroli zakażeń, lecz wykorzystują inne, dopuszczone przez producenta procedury dekontaminacji.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie przedmiotowego wymagania lub dopuszczenie równoważnych metod dekontaminacji zgodnych z instrukcją producenta oferowanego urządzenia.

Odp.: Zamawiający w załączniku nr 2.5 do SWZ Formularz właściwości techniczno – użytkowych Urządzenia objętego częścią 4 zamówienia w dziale II **POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU II. GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU** – w związku z omyłką pisarską –wykreśla punkt 4.

Pyt. 85

Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny dotyczy zadania nr 5- Warunki udziału w postępowaniu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego ogólnie wykorzystywanego w placówkach medycznych, w szczególności w szpitalach, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł?

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania przez Wykonawcę dwóch dostaw odpowiadających rodzajowi zamówienia, tj. dostaw maszyn do dozowania formaliny, których łączna wartość wynosi co najmniej 250 000,00 zł.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że oferowane rozwiązanie, tj. maszyna do dozowania formaliny, jest rozwiązaniem rynkowo tańszym niż kwota 250 000,00 zł. W praktyce oznacza to, że wykonawcy

oferujący tego rodzaju maszyny mogą nie posiadać pojedynczej referencji na dostawę takiego urządzenia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł, mimo że posiadają realne i adekwatne doświadczenie w zakresie dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

Odp.: W SWZ Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, 1. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do wykonania zamówienia (...) Za odpowiadające rodzajowi zamówienia Zamawiający uzna:

Dla części 5 zamówienia – dwie dostawy odpowiadające rodzajowi zamówienia, tj. dostawa maszyn do dozowania formaliny, których łączna wartość wynosi co najmniej 250 000,00 zł.

Pyt. 86

Dot. części 8

Dotyczy rozdziału IV. Termin wykonania zamówienia ust. 2)

Czy w ramach części 8 Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia instrukcji serwisowej DTR lub szczegółowego wykazu czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów? Z dostawą przekazemy wszystkie dokumenty potrzebne użytkownikowi, tj. instrukcję obsługi oraz mycia i dezynfekcji.

Z uwagi na zaawansowaną technologię instrukcja serwisowa udostępniana jest tylko punktom serwisowym, posiadającym przeszkolony przez Producenta personel oraz wymagane przez niego wyposażenie. Spowodowane jest to odpowiedzialnością producenta za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych kalibracji i napraw mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu, a użytkownik naszego sprzętu być narażony na roszczenia finansowe ze strony pacjenta lub personelu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmian opisanych w pytaniu.

Pyt. 87

Dot. części 8

Dotyczy rozdziału VI. Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty oraz projektu umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosił do 48 godzin?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmian opisanych w pytaniu.

Pyt. 88

Dot. części 8

Dotyczy rozdziału VI. Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty oraz projektu umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmian opisanych w pytaniu.

Pyt. 89

Dotyczy formularza właściwości techniczno-użytkowych (załącznik nr 2.8 do SWZ)

Czy Zamawiający może potwierdzić iż, w ramach dostawy zestawów do histeroskopii – 3 komplety oczekuje dostawy po 3 szt. z każdej opisywanej pozycji z wyjątkiem pozycji 6, gdzie Zamawiający wymienia ilość 18 szt.?

Odp.: Zamawiający w ramach dostawy zestawów do histeroskopii – 3 komplety oczekuje dostawy po 3 szt. z każdej opisywanej pozycji z wyjątkiem pozycji 6, gdzie Zamawiający wymienia ilość 18 szt.

Pyt. 90

Dotyczy formularza właściwości techniczno-użytkowych (załącznik nr 2.8 do SWZ)

Dot. lp. 5 tabeli „Światłowód typ CF, bezpieczny w procedurach inwazyjnych” – Czy Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie spełnienia wymogu, oświadczenie producenta zawarte w IFU, potwierdzające zgodność części aplikacyjnej typu CF z normą IEC 60601-1?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania postawione w Załączniku nr 2.8 do SWZ dot. lp. 5.

Pyt. 91

Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Dot. § 5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ust. 9 w następujący sposób: *Wykonawca gwarantuje minimum 8-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych?*

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację § 5 ust. 9 projektu umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie postanowienia, uznając je za adekwatne do swoich potrzeb oraz zapewniające właściwe zabezpieczenie ciągłości eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Pyt. 92

Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Dot. § 7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości naliczonych kar umownych dla części 8 do 20% wartości brutto umowy?

Odp.: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na proponowaną modyfikację w zakresie ograniczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych.

W związku z powyższym § 7 ust. 6 PPU otrzymuje brzmienie:

„6. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 30% wartości brutto Umowy. Odstąpienie od Umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania zapłaty kar umownych.”

Pyt. 93

Część nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik ginekologiczny dwu łyżkowy Kallmorgen o wym.

90x36 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 94

Część nr 7 poz. 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik ginekologiczny dwu łyżkowy Kallmorgen o wym.

75x23 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 95

Część nr 7 poz. 23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na szynę środkową o wym. 225x20 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 96

Część nr 7 poz. 24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na separator o wym. 40x22x30 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 97

Część nr 7 poz. 25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy o wym. 515x245x50 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 98

Część nr 7 poz. 26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy o wym. 515x245x70mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 99

Część nr 7 poz. 27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy o wym. 240x250x50 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 100

Część nr 7 poz. 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy o wym. 405x250x50 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 101

Część nr 7 poz. 35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Hegar Mayo dł. 180 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 102

Część nr 7 poz. 38. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki do ligatury jedno ucho złote drugie czarne pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 103

Część nr 7 poz. 39. Czy Zamawiający może doprecyzować czy sonda maciczna Sims ma być giętka czy sztywna?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje: Sonda Maciczna SIMS wyskalowana sr. 4 długość 330 mm – sztywna.


Pyt. 104

Część nr 7 poz. 52. Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę ginekologiczną Recamier o dł. 210 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 105

Część nr 7 poz. 59. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny Balfour max rozszerzenia 285 mm wysokość 205 mm dł. 320 mm?

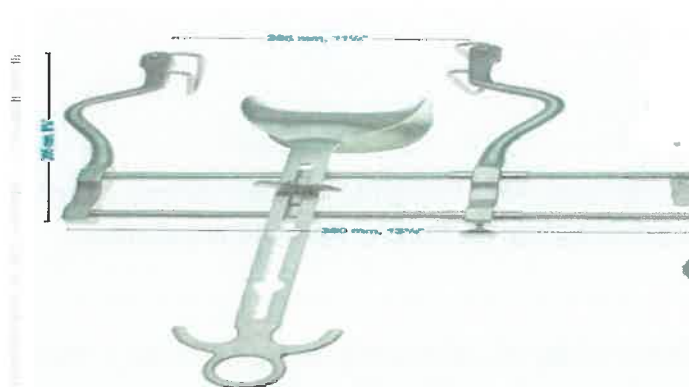

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 106

Część nr 7 poz. 60. Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę środkową do rozwieracza o wym. 55x70 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 107

Część nr 7 poz. 63. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak operacyjny Fritsch o wym. 75x48 mm dł. 255 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 108

Część nr 7 poz. 64. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak powłokowy Mikulicz o dł. 260 mm o wym. 120x50 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 109

Część nr 7 poz. 65. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki histerektomijne Heaney atraumatyczne dł. 210 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 110

Część nr 7 poz. 66. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki atraumatyczne de Bakey o dł. 250 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 111

Część nr 7 poz. 72. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki preparacyjne Overholt dł. 210 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 112

Część nr 7 poz. 74. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kulkociąg Schroeder 2x2 dł. 240 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 113

Część nr 7 poz. 76. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne De Bakey dł. 250 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 114

Część nr 7 poz. 79. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne Mayo Harrington dł. 220 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 115

Część nr 7 poz. 80. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne Daver dł. 140 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 116

Część nr 7 poz. 81. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne Standard dł. 140 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 117

Część nr 7 poz. 82. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki jelitowe Allis dł. 150 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 118

Część nr 7 poz. 84. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 119

Część nr 7 poz. 86. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odciągacz do mięśni Doyen dł. 165 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 120

Część nr 7 poz. 89. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy o wym. 515x245x100 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 121

Część nr 7 poz. 90. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak operacyjny Fritsch o dł. 265 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 122

Część nr 7 poz. 91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę Recamier o dł. 360 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 123

Część nr 7 poz. 94. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Hegar Mayo dł. 240 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 124

Część nr 7 poz. 95. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki do ligatury jedno ucho złote drugie czarne pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 125

Część nr 7 poz. 96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Mayo dł. 180 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 126

Część nr 7 poz. 97. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne dł. 170 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 127

Część nr 7 poz. 99. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe Crile Rankin? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 128

Część nr 7 poz. 103. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki do opatrunków Foerster? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 129

Część nr 7 poz. 106. Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę jelitową i brzuszną Reverdin o wym. łyżki górnej 61 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 130

Część nr 7 poz. 108. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zestaw wzierników ginekologicznych Kristeller o dł. 185 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 131

Część nr 7 poz. 110. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Hegar Mayo dł. 160 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 132

Część nr 7 poz. 111. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne Mayo dł. 150 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 133

Część nr 7 poz. 112. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik odbytniczy dwu ramienny ze śrubą o dł. 215 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 134

Część nr 7 poz. 113. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Toennis o dł. 180 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 135

Część nr 7 poz. 117. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki jelitowe Baby Allis dł. 125 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 136

Część nr 7 poz. 116. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Rampley nie atruamacyjne?

Odp.:

Pyt. 137

Część nr 7 poz. 117. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Crille Wood dł. 150 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 138

Część nr 7 poz. 120. Czy Zamawiający wyraża zgodę na szyne ograniczającą o wym. 235x18x9 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 139

Część nr 7 poz. 124. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe Micro Halsted Mosquito?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 140

Część nr 7 poz. 128. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Webster dł. 130 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 141

Część nr 7 poz. 129. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Baumgartner Hegar dł. 140 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 142

Część nr 7 poz. 130. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Toennis dł. 180 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 143

Część nr 7 poz. 135. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz Aicon o wym. 240x250x70 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 144

Część nr 7 poz. 136. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak operacyjny Fritsch dł. 250 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 145

Część nr 7 poz. 140. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze od języka Heyewood dł. 215 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 146

Część nr 7 poz. 151. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak operacyjny Kocher o wym. 80x65 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 147

Część nr 7 poz. 152. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz Weitlaner dł. 135 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 148

Część nr 7 poz. 154. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny Mikulicz o wym. 86x55mm dł. 260 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 149

Część nr 7 poz. 155. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny Mikulicz 90x35mm ł. 260 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 150

Część nr 7 poz. 156. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny o wym 155x50 mm dł. 260 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 151

Część nr 7 poz. 165. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Winter dł. 290 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 152

Część nr 7 poz. wszystkie Czy Zamawiający może doprecyzować w formularzu asortymentowo cenowym jedn. Masy jest podana szt. i kpl., bez ilości rozumiem że domyślna jest w ilości 1 (czyli 1 szt lub 1 komplet)?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje: jednostka sztuk oznacza pojedynczy element, w ramach jednej pozycji, a jednostka komplet oznacza komplet w ramach jednej pozycji. Zamawiający doprecyzował ilości dla wszystkich pozycji korygując Załącznik nr 2.7 do SWZ tj. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Urządzenia objętego częścią 7 zamówienia. Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu narzędzi operacyjnych - stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej W załączeniu – „skorygowany Zał 2.7 Zestaw narzędzi operacyjnych stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej 14 2026 DZP”

Wszystkie pozycje i ich ilości określone w „skorygowanym_Zał_2.7_Zestaw narzędzi operacyjnych stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej_14_2026_DZP” dotyczą 1 zestawu narzędzi operacyjnych stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej.

Pyt. 153

Część 9

Dostawa ciepłarki płynów infuzyjnych – 1 szt.

ad.1

Prosimy o dopuszczenie pojemności komory: max 31,5l netto (44l brutto)

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 154

Część 9

ad.2

Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 - 41 °C, II 42 - 70 °C) co 0,5 °C

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 155

Część 9

ad.3

Prosimy o dopuszczenie komory o wymiarach: 380 mm x 370 mm x 510 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 156

Część 9

ad.4

Prosimy o dopuszczenie temperatury pracy: 10-30 °C

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 157

Część 9

ad.6

Prosimy o dopuszczenie temperatury otoczenia (magazynowanie): 5 - 55 °C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 158

Część 9

ad.7

Prosimy o dopuszczenie wilgotności względnej 30% do 70%

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 159

Część 9

ad.8

Prosimy o dopuszczenie wagi 19 kg

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 160

Część 9

ad.9

Prosimy o odstąpienie od zapisu „do ogrzewania innych niepłynnych przedmiotów”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z Załącznikiem nr 2.9 do SWZ, punkt 9.

Pyt. 161

Część 9

ad.10

Prosimy o dopuszczenie obudowy z płyty PWC zapewniającej izolację termiczną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 162

Część 9

ad.12

Prosimy o odstąpienie od zapisu "płynów do dializy otrzewnowej, strzykawek i innych akcesoriów medycznych"

Odp.: Zamawiający odstępuje od zapisu opisanego w pytaniu. Pozostałe wymagania w tym zakresie zgodnie z Załącznikiem 2.9 do SWZ poz. 12.

Pyt. 163

Część 9

ad.13

Prosimy o dopuszczenie dezynfekcji za pomocą zamontowanych wewnątrz diod UV-C

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 164

Część 9

ad.14

Prosimy o dopuszczenie ogrzewania za pomocą kondukcji i konwekcji

Odp.: Pytanie nie dotyczy Załącznika nr 2.9 do SWZ, punkt 14

Pyt. 165

Część 9

ad.16

Prosimy o dopuszczenie komory grzewczej wyposażonej w przezroczystą pokrywę i automatyczne zamykanie

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę opisaną w pytaniu pod warunkiem, że jeśli funkcja zamykania jest równoważona z domykaniem.

Pyt. 166

Część 9

ad.23

Prosimy o dopuszczenie pojemności do ogrzewania w przybliżeniu 15 butelek 1l, worki 3l-5 szt., worki 5 l-3 szt.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis i dodaje do opisy przedrostek „Nie mniej niż”

Pyt. 167

Część 9

ad.27

Prosimy o odstąpienie od zapisu"

Odp.: Pytanie nieczytelne.

Pyt. 168

Część 9

Dostawa ciepłarki płynów infuzyjnych – 1 szt.

ad.1

Prosimy o dopuszczenie pojemności komory: max 31,5l netto (44l brutto)

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 169

Część 9

ad.2

Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 - 41 °C, II 42 - 70 °C) co 0,5 °C

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 170

Część 9

ad.3

Prosimy o dopuszczenie komory o wymiarach: 380 mm x 370 mm x 510 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 171

Część 9

ad.4

Prosimy o dopuszczenie temperatury pracy: 10-30 °C

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 172

Część 9

ad.6

Prosimy o dopuszczenie temperatury otoczenia (magazynowanie): 5 - 55 °C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 173

Część 9

ad.7

Prosimy o dopuszczenie wilgotności względnej 30% do 70%

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 174

Część 9

ad.8

Prosimy o dopuszczenie wagi 19 kg

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 175

Część 9

ad.9

Prosimy o odstąpienie od zapisu „do ogrzewania innych niepłynnych przedmiotów”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z Załącznikiem nr 2.9 do SWZ, punkt 9.

Pyt. 176

Część 9

ad.10

Prosimy o dopuszczenie obudowy z płyty PWC zapewniającej izolację termiczną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 177

Część 9

ad.12

Prosimy o odstąpienie od zapisu" płynów do dializy otrzewnowej, strzykawek i innych akcesoriów medycznych"

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 178

Część 9

ad.13

Prosimy o dopuszczenie dezynfekcji za pomocą zamontowanych wewnątrz diod UV-C

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany opisane w pytaniu.

Pyt. 179

Część 9

ad.14

Prosimy o dopuszczenie ogrzewania za pomocą kondukcji i konwekcji

Odp.: Pytanie nie dotyczy Załącznika nr 2.9 do SWZ, punkt 14.

Pyt. 180

Część 9

ad.16

Prosimy o dopuszczenie komory grzewczej wyposażonej w przezroczystą pokrywę i automatyczne zamykanie

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę opisaną w pytaniu pod warunkiem, że jeśli funkcja zamykania jest równoważana z domykaniem.

Pyt. 181

Część 9

ad.23

Prosimy o dopuszczenie pojemności do ogrzewania w przybliżeniu 15 butelek 1l, worki 3l-5 szt., worki 5 l-3 szt.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis i dodaje do opisy przedrostek „Nie mniej niż”

Pyt. 182

Część 9

ad.27

Prosimy o odstąpienie od zapisu" Bezpieczeństwo: elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu"

Odp.: Zamawiający dopuszcza stosowanie jednego z zabezpieczeń: mechanicznego bądź elektronicznego.

Pyt. 183

Część 9

Ad.32

Prosimy o odstąpienie od zapisu"Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie

przed przegrzaniem”

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu mechanicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem i dopuszcza również zabezpieczenie elektroniczne.

Pyt. 184

Część 9

Ad.34

Tak, rozwiązania równoważnego, polegającego na uruchamianiu wymuszonego obiegu powietrza dodatkowym wentylatorem.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z Załącznikiem nr 2.9 do SWZ, punkt 34.

Pyt. 185

Część 9

Ad.4 (pozostałe wymagania/warunki udziału)

Prosimy o odstąpienie od zapisu: Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134°C, czas ekspozycji 7 min., 121°C czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy

Odp.: Zamawiający w załączniku nr 2.9 do SWZ Formularz właściwości techniczno – użytkowych Urządzenia objętego częścią 6 zamówienia w dziale II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU II. GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU – w związku z omyłką pisarską –wykreśla punkt 4.

Pyt. 186

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odp.: Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 8.07.2026 r.

Pyt. 187

Pytania do pakietu 2.09 ciepłarki medyczne

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę do płynów infuzyjnych o pojemności 30l netto / 36l brutto co pozwala na 12 butelek 1000 ml lub 24 butelki 500 ml lub 2 worki 5000 ml lub 3 worki 3000 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 188

Pytania do pakietu 2.09 ciepłarki medyczne

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę do płynów infuzyjnych o zakresie regulowania temp. 25°C do 70°C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 189

Pytania do pakietu 2.09 ciepłarki medyczne

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę do płynów infuzyjnych o wymiarach 350 x 620 x 400 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 190

Pytania do pakietu 2.09 cieplarki medyczne

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę do płynów infuzyjnych o temperaturze otoczenia w pracy 15°C do 25°C?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 191

Pytania do pakietu 2.09 cieplarki medyczne

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę do płynów infuzyjnych o przechowywaniu w zakresie 10°C do 55°C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 192

Pytania do pakietu 2.09 cieplarki medyczne

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę do płynów infuzyjnych o wilgotności względnej 30% do 70%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 193

Pytania do pakietu 2.09 cieplarki medyczne

8. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę do płynów infuzyjnych o Wadze 21kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 194

Pytania do pakietu 2.09 cieplarki medyczne

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę do płynów infuzyjnych z płytą izolacyjną PVC oferującą wysoką wydajność cieplną oraz łatwość w czyszczeniu i dezynfekcji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 195

Pytania do pakietu 2.09 cieplarki medyczne

Czy Zamawiający wymaga funkcji programatora dziennego/tygodniowego pracy urządzenia z możliwością dostosowania do harmonogramu pracy Personelu? Funkcja umożliwia automatyczne ON/OFF urządzenia co wpływa na zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Odp.: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pyt. 196

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dwoma dolnymi szufladami i jedną górną komorą z drzwiczkami w której są wysuwane teleskopowe półki umożliwiające łatwy dostęp i załadunek?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 197

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o zakresie temp. 25°C do 70°C i regulacji co 0,5°C

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 198

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający dopuści alarm wysokiej temperatury: +5°C względem żądanej temperatury przez 5 minut (wizualny i akustyczny)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 199

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający wymaga rejestrowania temperatury oraz eksportu danych?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 200

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o ilości półek : 3?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 201

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o wymiarach 690 x 740 x 1770 mm (z odbojnikami: 740 x 790 x 1770 mm)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 202

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o maksymalnym obciążeniu szuflady 40kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w pytaniu

Pyt. 203

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający dopuści medyczną cieplarkę płynów infuzyjnych i tkanin o mocy znamionowej 1400 W?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 204

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający wymaga dezynfekcji wkładu poprzez promieniowanie UV-C, które eliminuje patogeny, grzyby, bakterie, wirusy oraz koronawirusy.

Odp.:

Pyt. 205

Pytania do pakietu 2.10

Czy Zamawiający wymaga programatora czasowego pozwalająca ustawić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia?

Rozwiązanie pozwala obniżyć opłaty za energię elektryczną.

Czy zamawiający wymaga opcji "BOOST" przyspieszającej ogrzewanie wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury?

Odp.: Pytanie nie dotyczy części 10 zamówienia

Pyt.206**Pytania do pakietu 2.10**

Czy Zamawiający dopuści ekran 3.2 cala oraz dotykowy panel sterujący?

Odp.: Pytanie nie dotyczy części 10 zamówienia

Pyt.207

zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia równoważnego lub lepszego o wymiarach 650 x 720 x 1950mm (s x g x w)

Odp. Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnienia treści SWZ, ponieważ Oferen nie wskazał, której części zamówienia dotyczy pytanie.

Pyt.208

zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia równoważnego lub lepszego o wydajności pompy myjącej 600l/min. Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego, że oferowane urządzenie jest zgodne z wszelkimi wymogami w tym normą EN15883, a co za tym idzie wydajność pompy jest dobrana konstrukcyjnie dla osiągnięcia znakomitej skuteczności mycia i płukania przy jednoczesnej oszczędności mediów (w tym wypadku wody). Jednocześnie parametr wydajności pompy nie jest uwzględniony w żadnym certyfikacie lub normie ponieważ badany jest efekt mycia i dezynfekcji, a nie zastosowane podzespoły. Z tego należy wysnuć również wniosek, że zastosowanie tego parametru ma jedynie na celu zawężenie konkurencji wbrew zapisom UoZP o uczciwej konkurencji i dyscyplinie finansów.

Odp. Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnienia treści SWZ, ponieważ Oferen nie wskazał, której części zamówienia dotyczy pytanie.

Pyt.209

zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia równoważnego lub lepszego, które postulat Konceptji cyklu prędkości realizuje finezyjnie dopasowanymi programami (40 programów) do wrażliwości wsadu. Oferowane rozwiązanie eliminuje prawdopodobieństwo błędnego automatycznego rozpoznania wsadu.

Odp. Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnienia treści SWZ, ponieważ Oferen nie wskazał, której części zamówienia dotyczy pytanie.

Pyt.210

zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Zamawiający przewiduje podłączenie myjni do wyciągu?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnienia treści SWZ, ponieważ Oferen nie wskazał, której części zamówienia dotyczy pytanie.

Pyt.211**Dotyczy rozdziału V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia**

Dot. części nr 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie co najmniej jednej dostawy urządzeń z zakresu urologii o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł?

Odp.: W SWZ Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, 1. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia (...) Za odpowiadające rodzajowi zamówienia Zamawiający uzna:

Dla części 8 zamówienia – co najmniej jedna dostawa urządzeń z zakresu urologii o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł

Pyt.212

Pytania do pakietu 2.8

Dotyczy formularza właściwości techniczno-użytkowych (załącznik nr 2.8 do SWZ) II pozostałe wymagania / warunki udziału w zamówieniu lp. 4

Zamawiający zwraca się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących metod sterylizacji oferowanego histeroskopu.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeznaczone do sterylizacji wyłącznie w parze wodnej w nadciśnieniu w temperaturze 134°C, zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu medycznego?

Uzasadnienie:

Sterylizacja parowa w temperaturze 121°C jest obecnie metodą rzadko rekomendowaną dla nowoczesnych endoskopów sztywnych i ich elementów optycznych. Wielokrotne procesy prowadzone w tej temperaturze przy wydłużonym czasie ekspozycji mogą niekorzystnie wpływać na trwałość elementów optycznych, połączeń klejonych oraz uszczelnień urządzenia. W związku z tym producent oferowanego wyrobu rekomenduje wyłącznie sterylizację parową w temperaturze 134°C.

W zakresie sterylizacji niskotemperaturowej (plazmowej) zgodność wyrobu z określonym systemem sterylizacji może być potwierdzona wyłącznie przez producenta danego sterylizatora oraz zwalidowany proces sterylizacji. Producent oferowanego wyrobu nie rekomenduje sterylizacji plazmowej jako wymaganej metody dekontaminacji, dlatego prosimy o odstąpienie od obligatoryjnego wymogu dopuszczenia sterylizacji plazmowej.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu SWZ np na:

„Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w temperaturze 134°C, zgodnie z instrukcją użytkowania i zaleceniami producenta wyrobu medycznego. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji, personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę opisaną w pytaniu.

Zamawiający informuje, że zmienia treść zapisu PPU § 7 ust.6 we wszystkich częściach zamówienia w następujący sposób:

„6. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 30% wartości brutto Umowy. Odstąpienie od Umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania zapłaty kar umownych.”

p.o. DYREKTORA SZPITALA
Igor Radziejewicz-Winnicki

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Barbara Bukowska

**FORMULARZ
ASORTYMENTOWO-CENOWY
Urządzenia objętego częścią 7 zamówienia**

Dostawa zestawu narzędzi operacyjnych - stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej										
Przedmiot zamówienia:										
Nazwa Wykonawcy:										
Producent:										
Rok produkcji (nie starszy niż 2025):										
Kraj pochodzenia:										
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikujący/a oferowany produkt nr katalogowy
						stawka (%)	kwota			
1.	ZESTAW WZIERNIKÓW GINEKOLOGICZNYCH TYP KRISTELLER (LYZKA DOLNA) WYMIARY 110X36MM DŁUGOŚĆ 20MM	SZT.	22							
2.	WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWULYZKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYZEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200MM	KPL.	22							
3.	WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWULYZKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYZEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ 170 MM	KPL.	22							
4.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
5.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
6.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
7.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
8.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
9.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
10.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
11.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
12.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
13.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 11 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							

14.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
15.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
16.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
17.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
18.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
19.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
20.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
21.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
22.	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	9							
23.	SZYNA ŚRODKOWA O WYMIARACH 213X67X16MM Z UCHWYTEM MONTAZOWYM DO KOSZA	SZT.	18							
24.	SEPARATOR O WYMIARACH 40X5X30MM DO MOCOWANIA DO SZYNY ŚRODKOWEJ	SZT.	180							
25.	KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DŃA I ZAKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNETRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 537 X 250 X 55 MM, MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF	SZT.	10							
26.	KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DŃA I ZAKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNETRZNE 537 X 250 X 80 MM MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIE TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF	SZT.	30							
27.	KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DŃA I ZAKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNETRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 240 x 250 x 55 MM MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF	SZT.	20							
28.	KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DŃA I ZAKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNETRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 403 X 250 X 55 MM MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF	SZT.	25							
29.	KLESZCZE DO BIOPSH TYP SCHUMACHER, DUŻE, PROSTE 305 mm (12"); DŁUGOŚĆ. 240 mm, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 9,80 mm	SZT.	2							

30.	NOŻYCKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM; DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TEPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKŁADKĄ ZŁOITE LUCHA	SZT.	2						
31.	KLESZCZE ŁOZYSK.-PORON WINTER #1 PROSTE DŁUGOŚĆ 290 MM	SZT.	3						
32.	KULOCIĄG TYP SCHROEDER 1 X IZ. DŁUGOŚC 250MM	SZT.	35						
33.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR- MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZEŚĆ ROBOCZA Z TWARDA WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYZOWO SKOK 0,5 MM	SZT.	12						
34.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR- MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZEŚĆ ROBOCZA Z TWARDA WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYZOWO SKOK 0,5 MM	SZT.	11						
35.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR- MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZEŚĆ ROBOCZA Z TWARDA WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYZOWO SKOK 0,5 MM	SZT.	21						
36.	NOŻYCKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TEPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKŁADKĄ ZŁOITE LUCHA	SZT.	20						
37.	NOŻYCKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TEPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKŁADKĄ ZŁOITE LUCHA	SZT.	20						
38.	NOŻYCKI DO ŁIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TEPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKŁADKĄ ZE SZLIPEM FAALISTYM ZŁOITE LUCHA	SZT.	5						
39.	SONDA MACICZ.SIMS WYSKALOW.SR.4/ DŁUGOŚC 330MM	SZT.	20						
40.	WZIERNIK ODBYTNICZY TYP SIMS WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 77 MM SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 160 MM. BELNY	SZT.	2						
41.	WZIERNIK ODBYTNICZY TROJRAMIENNY ZE SRUBĄ BLOKUJĄCĄ ROZWARCIE TYP MATHIEU WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 95 MM SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚC CAŁEGO NARZĘDZIA 215 MM	SZT.	2						
42.	ŁYZECZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OST/SZ.UCH.#00 4.5MM	SZT.	4						
43.	ŁYZECZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OST/SZ.UCH.#0 7.5MM	SZT.	4						
44.	ŁYZECZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OST/SZ.UCH.#1 8.5MM	SZT.	4						
45.	ŁYZECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#2 10.5MM	SZT.	4						
46.	ŁYZECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#3 12.0MM	SZT.	4						
47.	ŁYZECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#4 14.0MM	SZT.	4						
48.	ŁYZE.MACI RECAMIER OST/SZ.UCH.#5 15.0MM	SZT.	4						
49.	ŁYZECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#6 16.5MM	SZT.	4						

70.	KLESZCZYKI PŁUCNE TYP ALLIS PROSTE, DŁUGOŚĆ 220 mm (8 3/4"), SZCZĘKA: ZĄBKOWATA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 mm	SZT.	2							
71.	KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE JAJNIKOWE, OWALNE, PROSTE 250 mm (9 3/4"), SZCZĘKA: ZĄBKI DE BAKLEY, Z EFEKTEM OKIENKOWYM, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 21 mm	SZT.	22							
72.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKOW 0,6 MM	SZT.	1							
73.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	1							
74.	KULOCIĄG TYP SCHROEDER 2X2Z, PROSTY 250MM	SZT.	1							
75.	KLESZCZYKI DO OTRZEWNINEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KONCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI	SZT.	22							
76.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DEBEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDA WKLADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYZOWO SKOK 0,4 MM	SZT.	2							
77.	NOŻYCYKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ ZŁOTE UCHA	SZT.	1							
78.	NOŻYCYKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ ZŁOTE UCHA	SZT.	2							
79.	NOŻYCYKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO- HARRINGTON DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE	SZT.	1							
80.	NOŻYCYKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP DAVER TĘPO OSTRZE DŁUGOŚĆ 145 MM	SZT.	1							
81.	NOŻYCYKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM	SZT.	1							
82.	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KONCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKOW 0,8 MM	SZT.	22							
83.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER- DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KONCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKOW 0,8 MM	SZT.	4							
84.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKOW 0,7 MM	SZT.	10							
85.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKOW 0,7 MM	SZT.	10							
86.	ODCIĄGACZ MIEŚNIAK TYP DOYEN 150MM	SZT.	1							
87.	NACZYNIJE LABORATORYJNE 1,0L	SZT.	1							
88.	KUBEK MIAROWY Z NOŻKĄ Z PODZIAŁKĄ 0,25L	SZT.	1							
89.	KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ PALISTEJ STRUKTURZE DŁA I ZAOKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNĘTRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 537 X 250 X 105 MM MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF	SZT.	1							

90.	HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 64X85 MM FIGURA 5 DŁUGOŚĆ 235 MM	SZT.	1						
91.	LYŻCZKA ŁOŻY-PORONIEN TYP RECAMIER SZEROKOŚĆ 39,5MM, DŁUGOŚĆ 370MM	SZT.	1						
92.	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200MM	SZT.	22						
93.	PINCETA ATRAUMATYCZNA SZCZĘKA SZEROKOŚĆ 2,0MM DŁUGOŚĆ 200MM	SZT.	12						
94.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR- MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZEŚĆ ROBOCZA Z TWARDA WKLADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM	SZT.	11						
95.	NOŻYCKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOITE LUCHA	SZT.	10						
96.	NOŻYCKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ ZŁOITE LUCHA	SZT.	5						
97.	NOŻYCKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 175 MM	SZT.	5						
98.	KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 7 MM	SZT.	10						
99.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKOW 0,7 MM	SZT.	5						
100.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKOW 0,7 MM	SZT.	5						
101.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKOW 0,9 MM	SZT.	5						
102.	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM	SZT.	2						
103.	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE	SZT.	4						
104.	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 30X16MM I 24X16 MM	KPL.	4						
105.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0	SZT.	1						
106.	LYZKA JELITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ LYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM	SZT.	1						
107.	KLESZCZE ŁOŻYSK-PORON TYP WINTER #3 OSTR.KONC. ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 290 MM	SZT.	2						

125.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KONCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	SZT.	4							
126.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM KONCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM	SZT.	4							
127.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM	SZT.	3							
128.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP WEBSTER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 125 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM	SZT.	5							
129.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM	SZT.	7							
130.	NOŻYCYKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KONCE TĘPO TEPE	SZT.	3							
131.	NOŻYCYKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TEPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE LUCHA	SZT.	1							
132.	ŚREDNIO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM PINCETA ANATOMICZNA	SZT.	1							
133.	PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KONCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA KONCÓWKA ROBOCZA WYMIAR 2 X 1 MM	SZT.	5							
134.	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 22X21 MM 29X30 MM DŁUGOŚĆ 2,80 MM	SZT.	4							
135.	KOSZ TYP AICON STANDARD 1/2 PARAMETRY NIE WIĘKSZE NIŻ: DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA: 240 mm, SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA: 250 mm, WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 80 mm	SZT.	4							
136.	HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 41X60 MM FIGURA 3 DŁUGOŚĆ 235 MM	SZT.	10							
137.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM	SZT.	9							
138.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	6							
139.	HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM	SZT.	6							
140.	KLESZCZE DO JEZYKA TYPU HEYWOOD-SMITH DŁUGOŚĆ 210 MM	SZT.	4							
141.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M	SZT.	2							

142.	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KONCE TEPO TEPE	SZT.	3							
143.	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM Z UTWARDZONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE KOŃCE TEPO	SZT.	5							
144.	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE NACZYNIOWE ; DO TEPE	SZT.	1							
145.	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 90 MM OSTRZA OSTRO OSTRE SCHLEGEL	SZT.	1							
146.	PINCETA A TRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY - SZCZĘKA I 5MM SZER 200MM	SZT.	3							
147.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	13							
148.	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KONCOWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	4							
149.	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 30X29 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	7							
150.	HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM	SZT.	8							
151.	HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 80X60 DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	1							
152.	ROZWIERACZ TYP WEITLANER POŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	1							
153.	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 105 MM ŁĄCZANY SRUBA	SZT.	6							
154.	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 86X85 DŁUGOŚĆ 255 MM	SZT.	10							
155.	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 91X35 DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	2							
156.	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 147X50 DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	2							
157.	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 180X50 DŁUGOŚĆ 260 MM	SZT.	2							
158.	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KONCOWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	10							
159.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	10							
160.	NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TEPO TEPE	SZT.	10							
161.	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE CZARNE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TEPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKŁADKA ZŁOTE UCHA	SZT.	2							
162.	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TEPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDA WKŁADKA ZŁOTE UCHA	SZT.	2							
163.	KLESZCZE PORODOWE SIMPSON-BRAUN 305MM	SZT.	2							
164.	KLESZCZE PORODOWE SIMPSON-BRAUN 350MM	SZT.	2							

165.	KLESZCZE ŁOŻYSK.-PORON. TYP WINTER #2 OSTR.KONC. ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 245MM	SZT.	2						
166.	NOŻYCYZ DO NAC.KROCZA BRAUN-STADLER 145MM	SZT.	2						
167.	NOŻYCYZKI PEPOWINOWE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM KONCE II PO II PE	SZT.	10						
168.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KONCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKII SKOK ZABKOWI 0,9 MM	SZT.	10						
169.	PINCETA ATRAUMATYCZNA. SZCZĘKA 2.8MM SZER.200MM	SZT.	10						
170.	KULOCIĄG TYP BRAUN I XIZ. DŁUGOŚĆ 250MM	SZT.	1						
RAZEM:									

II POZOSTALE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU			
Przedmiot zamówienia:			
Dostawa zestawu narzędzi operacyjnych - stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej			
II.	GWARANCJA/SERWIS/POZOSTALE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE WYMAGANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca)
1.	Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”	TAK, podać	
2.	Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji)	TAK, podać	
3.	Czas reakcji serwisu* technicznego na zgłoszone wady i usterek urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia	TAK, podać	
4.	Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadsięnienu w dwóch zakresach temperatur 134°C, czas ekspozycji 7 min., 121°C czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy	TAK	

5.	Narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocetlowanej (nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania — Data Matrix — zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia	TAK	
6.	Do oferty należy dołączyć oryginalny, ogólnie dostępny katalog ze zdjęciami i parametrami oferowanych narzędzi chirurgicznych	TAK	
7.	Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności — odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardej wkładki zgodnie z procesem) — załączyć: certyfikat jednostek notyfikowanych potwierdzający naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi	TAK	
8.	Łączenie połówek nożyceek wykonane centralnie za pomocą wkł.śr. nie nitowane	TAK	
9.	Wykonawca posiada na terenie UE fabryczny dział serwisu i regeneracji narzędzi chirurgicznych (dysponujący stosownym certyfikatem potwierdzającym świadczenie usług regeneracyjnych / serwisu technicznego narzędzi chirurgicznych na terytorium Polski) wydanych przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę certyfikującą i producenta) z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności	TAK	
10.	Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na Bloku Operacyjnym i Centralnej Sterylizatorni — przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi normami — obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według	TAK	
11.	Możliwość laserowego znakowania narzędzi chirurgicznych i kontenerów, wybranym przez Oferenta układem liter i cyfr, do ustalenia po wyborze oferty przez Zamawiacza	TAK	

*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: W kolumnie „POTWIERDZENIE WYMAGANEGO PARAMETRU” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

Słownie wartość netto 7 części zamówienia. złotych.

Słownie wartość brutto 7 części zamówienia. złotych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)